

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.064

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**UAB „Nordic Metrology Science“
Kontrolės įstaiga**

LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: UAB „Nordic Metrology Science“
juridinio asmens kodas: 120229395

ir yra kompetentinga vykdyti:

matavimo priemonių tikrinimą, kaip C tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2016-04-11**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-01-04**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-10-29***

Pažymėjimas galioja iki: **2026-04-05**

* pažymėjimo versija, Regionų administracinio teismo 2025-10-28 nutartimi administracinėje byloje Nr. e12-20627-983/2025 pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2025 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. AK-246 „Dėl UAB „Nordic Metrology Science“ kontrolės įstaigos akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ galiojimą, išskyrus tą dalį, kuria sustabdytas 2024 m. sausio 4 d. išduoto akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.06.064 galiojimas vienoje konkrečioje kontrolės srityje: Mechaninių slėgmačių su tampriuoju matavimo elementu veikla pagal BPM 111955219- 13:2023

Direktorė



DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Nordic Metrology Science“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai


Veiklos vykdymo vietų adresai pateikiami prieš nurodant konkrečiu adresu vykdomą akredituotą veiklą

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Elektroninės svarstyklės I tikslumo klasė – iki 10 kg II tikslumo klasė – iki 100 kg III, IIII tikslumo klasė – iki 20 000 kg	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Vagonų svarstyklės statiniame svėrimo režime matavimų ribos iki 200 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-09:2001 Pakeitimas 1
Automobilių svarstyklės matavimo ribos iki 60 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Mechaninės prekinės svarstyklės matavimo ribos iki 10 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000
Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančiosios svarstyklės (0...5000) kg ≥ 0,2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-97:2006
Automatinės pavienių produktų svarstyklės iki 3000 kg Neautomatiniame svėrimo režime XI ir Y(I), XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) klasė Automatiniame svėrimo režime (XI ... XIII), Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006
Automatinės nepertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės $Q_{max}=1000$ t/h ≥ 0,5 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-99:2006


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Automatinės fasavimo svarstyklės Fasuotės masė iki 3000 kg, ≥ 0,5 tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-111:2006
Elektros energijos skaitikliai Įtampa (30 ... 300) V Srovė 1 mA iki 120 A Fazės kampas iki 360° Energija P; Q Tikslumas (0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 1S, 2; 3) ir A, B, C klasės	Metrologinė patikra	BPM 303038190-14:2024
Matavimo liniuotės (0,5 ... 5,0) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-48:2010 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (0 ... 200) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-20:2010 Pakeitimas 1
Metrolazdės (0...5) m paklaida ±1mm ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-06:2013
Ilgio matavimo priemonės medienos ir žemės naudmenų matavimui (0 ... 100) m pirminei patikrai ± (c+1,5+L) mm periodinei patikrai ± 2(c+1,5+L) L- matuojamasis ilgis, m c=1 mm strypinėms kelių dalių kitoms c=0	Metrologinė patikra	BPM 8871101-116:2007 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Medžiagų ilgio matavimo priemonės Tikslumo klasė I, II, III matavimo ribos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-140:2013
Žerglės (0 ... 1,0) m ± (0,5 ... 10) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-115:2007
Sietai akutės 20 μm - 125 mm Paklaida ≥ ± 2,3 μm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-126:2013 Pakeitimas 1
Nivelyrai ±m _{km} aukščių skirtumo matavimo vidutinė kvadratinė paklaida, nurodyta nivelyro techniniuose dokumentuose	Metrologinė patikra	BPM 8871101-70:2007
Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai (0...10) m paklaida ≥ ± 1,5 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-118:2007 Pakeitimas 1
Skaitmeniniai gylmačiai automobilinių padangų protektoriaus rašto gylui matuoti Matavimų ribos ~ 25 mm	Metrologinė patikra	BPM 140216494-151:2014

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Paklaida $\geq \pm 0,02$ mm		
Slankmačiai (skaitmeniniai slankmačiai, slankmačiai su nonijaus skale ir slankmačiai su apskrita skale) matavimo ribos (0-2000) mm paklaida $\pm \Delta L, \text{mm}$ * *nurodyta gamintojo techniniuose dokumentuose	Metrologinė patikra	BPM 120229395-156:2018
Alyvos kolonėlės 1 - 100 dm ³ Tūrio matavimo paklaida $\pm 1,0$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-68:2002
Techniniai saikikliai vienos reikšmės $V_v < 50000$ dm ³ daugelio reikšmių $V_v < 2500$ dm ³ 1 ir 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-34:2001
Pieno tūrio matuokliai 10 dm ³ $\pm 0,05$ dm ³ 20 dm ³ $\pm 0,075$ dm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-74:2003
Stikliniai tūrio matavimo indai Būrėtės (1 - 100) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Pipetės (0,1 - 200) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Kolbos (1 - 5000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Cilindrai (5- 2000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Menzūros (50 - 1000) cm ³ , paklaida $\geq \pm 2,5$ cm ³ Mėgintuvėliai (5 - 25) cm ³ , paklaida $\geq \pm 0,1$ cm ³ Piknometrai (1 - 100) cm ³ , paklaida $\geq \pm 0,1$ cm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-17:2013
Plastikiniai tūrio matavimo indai Talpa (0,005...5) dm ³ Tikslumo klasė A, B	Metrologinė patikra	BPM 8871101-131:2008
Tūrio dozavimo matai: $V_v - (0,02 - 5)$ dm ³ , leidžiamoji paklaida $\geq \pm 2$ cm ³ arba $\geq \pm 3$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-33:2013
Laboratoriniai skysčių dozatoriai $V = (0,001 - 200)$ ml, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,2$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Vieno litro darbinės purkos, paklaida $\pm 4,0$ g/dm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-64:2002
Svarsčiai 1mg ... 20 kg F_1, F_2, M_1, M_2 ir M_3 tikslumo klasė paklaida $\pm (0,006... 1000000)$ mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-11:2008
Sekundmačiai mechaniniai iki 60 min, paklaida $\pm 0,8$ s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-60:2002
Sekundmačiai skaitmeniniai 9999,9 s paklaida $\leq \pm 5$ s/parą	Metrologinė patikra	BPM 8871101-119:2007
Pedaliniai ergometrai, galia iki 500 W, sukimosi dažnis iki 130 aps/min,	Metrologinė patikra	BPM 8871101-100:2006

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
galios paklaida ± 3 W iki 60 W, ± 5 % virš 60 W, sukimosi dažnio paklaida ± 2 aps/min.		
Dinamometriniai raktai (0,2 ... 3000) Nm, paklaida ± 4 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-105:2006
Spyruokliniai dinamometrai (0...500) kN 1, 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-53:2002
Areometrai Matavimo ribos: (650...1840) kg/m ³ Paklaida $\pm 0,5$ padalos ir didesnė Matavimo ribos: (0...105) tūrio % Paklaida $\pm 0,1$ tūrio % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-76:2003
Naftos densimetrai Matavimo ribos: (0,71...1,63) g/cm ³ Paklaida $\pm 0,0001$ g/cm ³ ir didesnė	Metrologinė patikra	Mažagabaritinio skaitmeninio skysčių tankio matuoklio Densimeter 921 Patikros metodika, patvirtinta 1996-01- 30
Medienos drėgmės matuokliai Matavimo ribos: (7...60) % Paklaida $\pm 0,2$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008
Grūdų drėgmės matuokliai Matavimo ribos: (0...100) % Paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-125:2008
Automatinis pliūpsnio temperatūros analizatorius FP 935 G Matavimo ribos: (40...450) °C Paklaida $\pm 0,035$ t _p ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 1067889-67:2000
Automatinė kapiliarinė viskozimetrinė sistema VISCO HOUILLON ATREM Matavimo ribos: (3...2000) mm ² /s Paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 4021649-62:2000
Kietųjų dalelių analizatoriai Matavimo ribos: (7...100) % Paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-136:2010
Stikliniai butirometrai Matavimo ribos: (0...40) % riebalų Paklaida $\pm 0,5$ padalos ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 2022939-43-96
Pieno analizatoriai (laktoskopai) (0...7) % riebalų Paklaida ± 1 % ir didesnė (0...5) % baltymų Paklaida ± 1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008

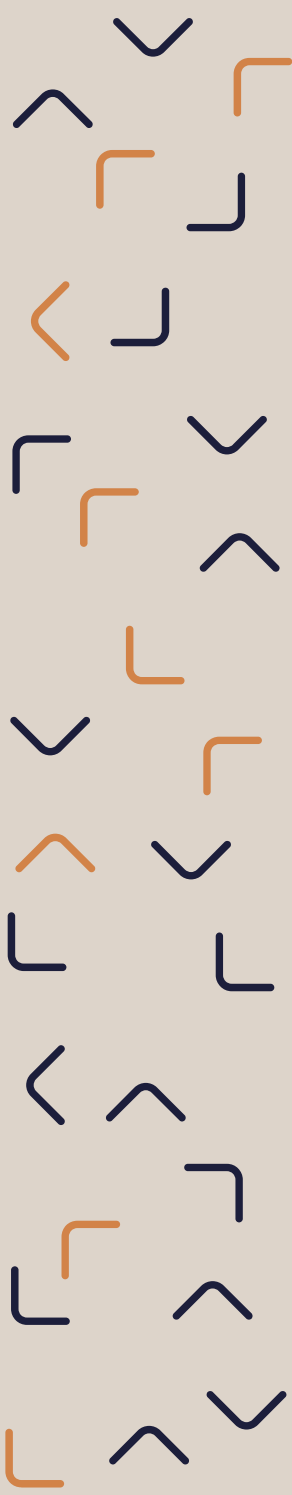

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Alkoholio koncentracijos iškvepiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo(0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126: β<0,4 mg/l ± ≤ (0,02...0,03) mg/l 0,4 mg/l ≤ β ≤ 2,0 mg/l ± ≤ (5...7,5)% β > 2,0 mg/l ± ≤((β/2-0,9)...((3·β)/4-1,35)) mg/l; pagal LST EN 15964: β ≤ 0,2 mg/l ± ≤ 0,02 mg/l β > 0,2 mg/l ± ≤ 10%	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
Dyzelinių variklių dūmingumo matavimo priemonės (dūmomačiai) (0...100) % Paklaida ± 1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-87:2004
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai temperatūra (0 - 55)°C, paklaida ± 0,3 % ir didesnė deguonies koncentracija (0 – 199,9) mg/l (0 - 600) % O ₂ , paklaida ± 0,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai (0 ... 5) tūr. % CO Paklaida ±5 % ir didesnė (0 ... 16) tūr. % CO ₂ Paklaida ±5 % ir didesnė (0 ... 2000) ppm HC Paklaida ± 5 % ir didesnė (0 ... 21) tūr. % O ₂ Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-79:2014
Sprogių/degių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai (5...50) % ASR/AUR Paklaida ± 3 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-112:2006
Toksinių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai 5 tūr. ppm - 2 tūr. % Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-121:2007
Nešiojami dujų analizatoriai EX-TEC GM4 Deguonies (O ₂) koncentracija. 0...25) tūrio % Paklaida 10 % arba ± 0,3 tūrio %	Metrologinė patikra	PM 120059523-02:2014
pH matuokliai (-2...12,45) pH Paklaida ± 0,01 pH ir didesnė (-1900...+1900) mV Paklaida ±1 mV ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003

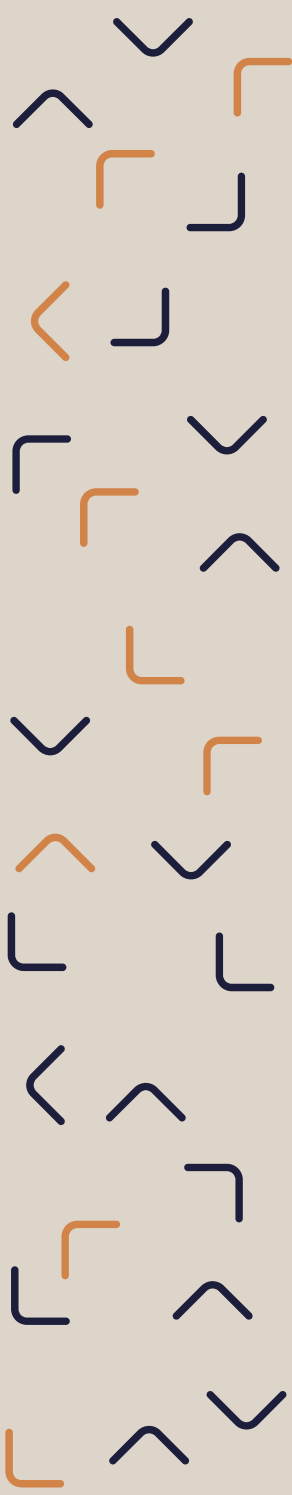


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
0,01 μS/cm...19,00 mS/cm Paklaida ±1,5 % ir didesnė (0...19) mg/l O ₂ Paklaida ± 1,5 % ir didesnė		
Elektriniai aspiratoriai Matavimo ribos: (0,2...50) l/min Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 2022939-19-98
Rotametrai (plūdiniai debitmačiai) Oro (dujų) debito matavimo ribos (0,0 3- 1,2) m ³ /h Paklaida ± (2...10) %	Metrologinė patikra	BPM 111955219-146:2013
Automobilių stiklų šviesos pralaidumo matavimo prietaisai CL 176 RS (0...100) % Paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 122757637-10:2006
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai (62...1000) s Paklaida ±1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014
Liukšmetrai (5...1500) lx Paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-77:2014
Liepsniniai fotometrai PFM (0...160 mmol/l Na ⁺ (0...10) mmol/l K ⁺ Paklaida ±0,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-157:2024
Fotoelektriniai kolorimetrai (0...100) % T Paklaida ± 1 % T ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 147146671-143:2013
Kietojo ir skystojo kuro kalorimetrai 40 000 ±100 J/K Paklaida ±0,1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-158:2024
Poliarimetrai (100...+100)°Z Paklaida ±0,02 °Z ir didesnė (-41...+41)° Paklaida ±0,03 ° ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-130:2008
Refraktometrai (1,32...1,7) n _d Paklaida ±1×10 ⁻⁴ n _d ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2010
Spektrofotometrai (220...900) nm Paklaida ± 0,5 nm ir didesnė (0...2) Å	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Paklaida $\pm 0,002$ A ir didesnė		
Stikliniai skysčio termometrai (-80...+600) °C 1, 2 tikslumo klasė paklaida $\pm (0,1...15)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-21:2024
Skaitmeniniai termometrai (-80...+600)°C paklaidos pagal termometro techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 8871101-22:2000
Manometriniai termometrai (0...300)°C tiksl. kl. 11,522,54	Metrologinė patikra	BPM 8871101-23:2000
Termometrai su ciferblatu (-80...+600)°C tiksl. kl. 12 paklaidos $\pm(2...10)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-101:2006
Maksimalus elektriniai termometrai (32,0...42,0)°C tiksl. kl 1 2 paklaidos $\pm(0,15...0,4)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-103:2006
Stikliniai skysčio tankio matuokliai (areometrų termometrai) (-25...+40)°C paklaidos $\pm(0,1...0,5)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-76:2003 BPM 8871101-30:2001
Varžiniai temperatūros jutikliai (-50...+600)°C tiksl. kl. AA, A, B, C, D paklaidos $\pm(0,1+0,0017 t ...1,2+0,12 t)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-51:2024
Keitiklis Pt 100/4-20mA $T_{min}...T_{max}$ (priklausomai nuo keitiklio modifikacijos arba nurodytos ant pačių temperatūros keitiklių) paklaidos $\pm 0,08$ mA	Metrologinė patikra	PM 1195589-63:2000
Infraraudonųjų spindulių termometrai (-50...1200) °C, leist.pakl. pagal termometro tech. dokumentacija	Metrologinė patikra	BPM 8871101-128:2008
Termoelektriniai temperatūros jutikliai (termoporos) (-40...1700)°C, leist. pakl. $\pm(1,0...2,5)$ °C nuo (-40...+333)°C ir $\pm(0,0025\cdot t...0,0075\cdot t)$ nuo (333...1700)°C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-52:2001
Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės (-50...70)°C, (2...100)% paklaidos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 Pakeitimas 1
Temperatūros savirašiai (-80...1600)°C Paklaidos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-150:2014

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai: ribos (-0,1...60) MPa slėgio skirtumas <400 kPa tiksl. kl.: 0,1 0,2 0,25 0,5	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Automobilių padangų slėgmačiai: ribos (0...1,2) MPa paklaidos pirminei (periodinei) patikrai: ±8 (±10) kPa ≤ 0,4 MPa ±16 (±20) kPa (0,4...1,0) MPa ±25 (±31) kPa > 1,0 MPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-40:2015
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i) kPa didžiausia leidžiamoji histerezės paklaida: ± 4mmHg ±0,5kPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-05:2015
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i)kPa didžiausia vidutinė matavimo paklaida ±5mmHg ± 0,7kPa	Metrologinė patikra	BPM 8871101-27:2018
Tonometrų (Kontaktiniai mechaniniai intraokulinio slėgio matuokliai): ribos (0...127,5) mmHg paklaidos: svarelių masei ± 20 mg skalės rodmenims: 5" – ±150mg 10" – ±200mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-127:2008
Srovės matavimo replės skaitmeninės Įtampa (0...1000) V, leidžiamoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau Srovė (0... 1000) A, leidžiamoji paklaida ± 0,6 % ir daugiau Varža (0 Ω... 400 MΩ) , leidžiamoji paklaida ± 0,1 % ir daugiau Dažnis (0,5 Hz... 10 MHz), paklaida ± 0,1 % ir daugiau Elektrinė talpa (0,5 nF...40 mF) paklaida ± 1 % ir daugiau	Metrologinė patikra	BPM 8871101-71:2002
Srovės matavimo replės analoginės Įtampa (0...100) V, prie f=(10...40) Hz leistinoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau Įtampa (0...1000) V, prie f=(40...1 000) Hz, leistinoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau Srovė (0... 1000) A, prie f=(10...65) Hz paklaida ± 1 % ir daugiau Varža (0 Ω... 40 MΩ) , leistinoji paklaida ± 0,6 % ir daugiau	Metrologinė patikra	BPM 8871101-72:2002

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Srovės matavimo transformatoriai $I_1 = (0,5 \dots 50000) \text{ A}$ $I_2 = (1 \dots 5) \text{ A}$ Tikslumo klasė – 0,1 0,2 0,2S 0,5 0,5S 1 3 10 5P 5PR 10P 10PR	Metrologinė patikra	BPM 8871101-03:2013
Įtampų transformatoriai Matavimo ribos: $U_1 (5 \dots 35) \text{ kV, t. kl. } (0,2 \dots 6P)$ $U_1 (35 \dots 245) \text{ kV, t. kl. } (0,5 \dots 6P)$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-63:2014 Pakeitimas 1
Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės Izoliacijos varža $(0 \dots 1 \text{ T } \Omega)$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,2 \text{ R}) \Omega$ Įžeminimo varža $(0 \dots 400) \text{ k}\Omega$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,2 \text{ R}) \Omega$ Specifinė grunto varža $(0 \dots 2000) \text{ k}\Omega\text{m}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,02 \cdot \rho) \Omega$ Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža $(0 \dots 20) \text{ k}\Omega$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,1 \text{ R}) \Omega$ Varža (trumpo jungimo, mikro/miliommetro) $(0 \dots 99) \text{ k}\Omega$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,05 \text{ R}) \Omega$ Varistoriaus įtampa $(0 \dots 1500) \text{ V}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,05 \text{ U}) \Omega$ Nuolatinė įtampa $(0 \dots 1050) \text{ V}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,05 \text{ U}) \text{ V}$ Kintama įtampa $(0 \dots 1000) \text{ V}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,05 \text{ U}) \text{ V}$ Kintamos srovės stipris $(0 \dots 1000) \text{ A}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,05 \text{ I}) \text{ A}$ Dažnis $(15 \dots 1200) \text{ Hz}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,001 \text{ f}) \text{ Hz}$ Talpis $(0,01 \dots 50) \mu\text{F}$ didžiausia leidžiamoji paklaida $\pm (0,15 \text{ C}) \mu\text{F}$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-69:2014
Analoginiai ommetrai, Matavimo ribos nuo $0,01 \Omega$ iki $1 \text{ G}\Omega$ Leidžiamoji paklaida $\pm 0,015 \%$ ir daugiau	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002
Izoliacijos varžos matuoklis METREL TeraOhm 5 kV nuolatinė įtampa (3 iki $600) \text{ V}$ leidžiamoji paklaida $\pm 3,0 \%$ kintama įtampa (3 iki $600) \text{ V}$ leidžiamoji paklaida $\pm 3,0 \%$ bandymo įtampa (250 iki $5000) \text{ V}$ leidžiamoji paklaida $\pm 3,0 \%$	Metrologinė patikra	PM 3264128-30:2002

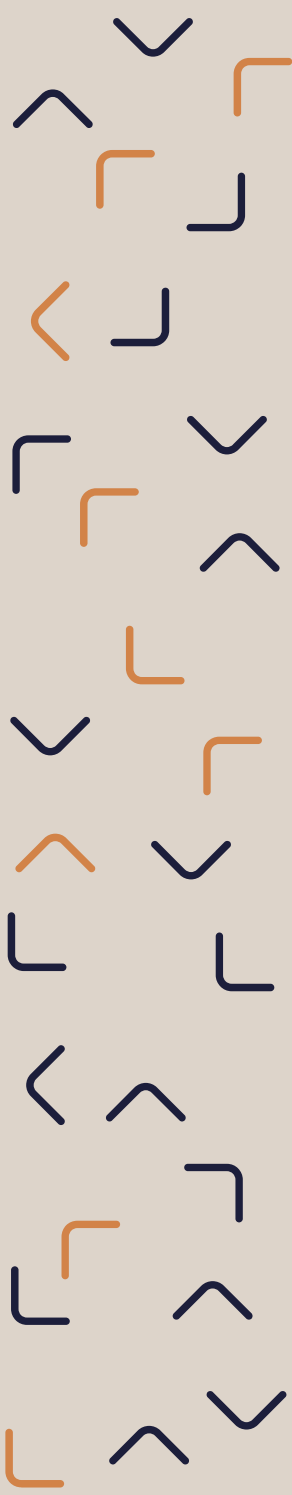


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
talpa (0,2 nF iki 50 μF) leidžiamoji paklaida ± 5,0 % varža (3 kΩ iki 5 TΩ) leidžiamoji paklaida ± 5,0 % ir daugiau		
Elektros tinklų matavimo sistemos UNITEST EURO EXPERT varža (0 ... 2000) MΩ leidžiamoji paklaida ± 2 % įtampa (100 ... 440) V leidžiamoji paklaida ± 2 % dažnis 50 Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % ir daugiau	Metrologinė patikra	PM 2022939-07-1999
Daugiafunkciniai instaliacijos matuokliai METREL EUROTTEST MI 3102, MI3102H, MI3101, MI3105, MI3102H CL, MI3102H BT, MI3152H Varžos matavimas (0 ... 199,9) MΩ ± 0,5% (0 - 999) MΩ ± (2 ... 10) % (0 - 19,99) Ω ± 3 %; (20 ... 1999) Ω ± 5 % Įtampos matavimas (0 ... 1200) V ± 3 % (0 - 500) V (50 Hz) ± 2 % Srovės matavimas (0 ... 99,9) mA ± 5 % (100 mA - 19,99 A) ± 5%	Metrologinė patikra	PM 135896117-3:2010 SPM 135896117-02:2018
Fazė – nulis kontūro impedanso matuoklis METREL MI 3122 Kintama įtampa (0 ... 550) V leidžiamoji paklaida ± 2 % Įnulinimo kontūro varža (0,0 ... 99,9)Ω leidžiamoji paklaida ± 5 % Įnulinimo kontūro varža (100Ω...9,99kΩ) leidžiamoji paklaida ± 10 %;	Metrologinė patikra	PM 135896117-6:2013
Replinis įžeminimo varžos matuoklis 4200 KYORITSU srovė (0 mA iki 31,5 A), leidžiamoji paklaida ± 2 %; varža (0 ... 599) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 224501371-07:2006
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis Metrel Eurotest 61557 METREL įtampa (2 ...440) V leidžiamoji paklaida ± 2 % dažnis (15,3 ... 99,9) Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % varža (0,02 ... 1999) Ω leidžiamoji paklaida ± 2 % varža (0,02 ... 1999) MΩ leidžiamoji paklaida ± 2 % ir daugiau	Metrologinė patikra	PM 3264128-27:2002
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis Macrotest HT5035 įtampa (100 ... 460) V leidžiamoji paklaida ± 3 % dažnis (47,0 ... 63,6) Hz	Metrologinė patikra	PM 2563935-12:2003

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
leidžiamoji paklaida $\pm 0,1 \%$ varža (0 ... 1999) Ω leidžiamoji paklaida $\pm 5 \%$ varža (0,01 ... 1999) $M\Omega$ leidžiamoji paklaida $\pm 2 \%$ ir daugiau		
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MPI-525	Metrologinė patikra	PM 302127533-05:2014
Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistema. Laiko paklaida ± 20 s per 7 paras	Metrologinė patikra	PM 120229395-18:2008 PM 111950581-09:2007 Pakeitimas1 PM 302250087-03:2012 PM 160430566-10:2010 SPM 120229395-01:2022
.		
Lazerinis transporto priemonių greičio matavimo prietaisas SL 700" (8... 350) km/h, leidžiamoji paklaida ± 2 km/h	Metrologinė patikra	PM 121793694-08-2006
Radiolokacinė transporto priemonių judėjimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo sistema BERKUT-VIZA Dažnis – 24,15 GHz, leidžiamas nuokrypis $\pm 0,1$ GHz Greitis (20 ... 250) Km/h, leidžiamoji paklaida ± 1 km/h – stacionariame režime ± 2 km/h – patruliniame režime	Metrologinė patikra	PM 244913310-02:2007
Radiolokacinis transporto priemonių greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo prietaisas VIZIR Dažnis – 24,15 GHz, I leidžiamas nuokrypis $\pm 0,1$ GHz Greitis (20 .. 250) km/h, leidžiamoji paklaida ± 1 km/h – stacionariame režime ± 2 km/h – patruliniame režime	Metrologinė patikra	PM 244913310-07:2008
Greičio matavimo sistema TraffSection VECTOR P2P Greičio matavimo paklaida kelyje: kai greitis mažesnis nei 100 km/h ± 2 km/h, kai greitis didesnis nei 100 km/h $\pm 2\%$.	Metrologinė patikra	SPM 120229395-03:2019
Lazerinis greičio matuoklis TruCAM greičio matavimo paklaida ± 2 km/h atstumo matavimo paklaida ± 15 cm greičio matavimo ribos (0...320) km/h transporto priemonės nuotolio matavimo minimalus atstumas greičio režime 15,25 m	Metrologinė patikra	PM 120229395-07:2010
Lazerinis greičio matavimo prietaisas TRAFFIPATROL greičio matavimo paklaida ± 2 km, kai greitis mažesnis nei 100 km/h $\pm 2 \%$, kai greitis didesnis nei 100 km/h greičio matavimo ribos (0...300) km/h atstumo galimybė matuojant greitį (10...500) m	Metrologinė patikra	PM 2029072-80:1999

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Lazerinis greičio matavimo prietaisas TRAFFIPATROL XR greičio matavimo paklaida ± 2 km/h, kai greitis mažesnis nei 100 km/h ± 2 %, kai greitis didesnis nei 100 km/h greičio matavimo ribos (0 ... 320) km/h transporto priemonės nuotolio matavimo ribos (10 ... 1500) m	Metrologinė patikra	PM 110736215-04:2007
Lazerinis greičio matuoklis TruSpeed greičio matavimo paklaida ± 2 km/h atstumo matavimo paklaida ± 0,015 m greičio matavimo ribos (0 ... 322) km/h	Metrologinė patikra	PM 120229395-01:2009
Transporto priemonių greičio matavimo sistemos greičio matavimo ribos (20 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida ≤ ± 1 km/h iki 100 km/h ≤ ± 1 % virš 100 km/h ≤ ± 2 km/h iki 100 km/h ≤ ± 2 % virš 100 km/h ≤ ± 3 km/h iki 100 km/h ≤ ± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	BPM 8871101-134:2013
Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema „PASScam“ (1 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida ≤ ± 3 km/h iki 100 km/h ≤ ± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	SPM 302664120-01:2018
Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema „PASScam“ 1 ... 299) km/h greičio matavimo paklaida (kai naudojamas rankinis stebimo ruožo ilgio įvedimas) ≤ ± 2 km/h iki 100 km/h ≤ ± 2 % virš 100 km/h greičio matavimo paklaida (kai stebimo ruožo ilgis nustatomas automatiškai) ≤ ± 3 km/h iki 100 km/h ≤ ± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	SPM 121793694-01:2020
Greičio matavimo sistema ITC EYE (1 ... 300) km/h ± 2 km/h	Metrologinė patikra	SPM 120229395-01:2017
Greičio matavimo sistema ITC EYE Compact 300 (1 ... 300) km/h ± 2 km/h	Metrologinė patikra	SPM 120229395-06:2019
Vibracijos matuoklį: vibracijos pagreitis (0,01 ... 5000) m/s ²	Metrologinė patikra	BPM 8871101-113:2007

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
leistinoji paklaida $\pm 3 \%$ ir didesnė.		
Akustinių triukšmų matuoklis 41AM, Nor118, garso lygis (30 ... 130) dB dažnis 20 Hz ... 20 kHz leistinoji paklaida $\pm 0,6$ dB ir didesnė.	Metrologinė patikra	PM 1001192-02:2004 Pakeitimas 1
Garso lygio matuokliai t.kl. 1, 2: garso lygis (20 ... 140) dB dažnis 20 Hz ... 20 kHz leistinoji paklaida $\pm 0,6$ dB ir didesnė.	Metrologinė patikra	BPM 120229395:155:2017
Pastatų akustinių charakteristikų sistema Nor1516 30 ... 130 dB 20 ... 16 000 Hz	Metrologinė patikra	PM 11153734-01:2008
Garso tono audiometrai 30 ... 130 dB 20 ... 8 000 Hz	Metrologinė patikra	BPM 221906050-139:2013
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo standai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi paklaida ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Stabdžių tikrinimo standai (0 ... 6) kN $\pm 3 \%$ (0 ... 40) kN $\pm 2 \%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-141:2013
Aplinkos dozės ekvivalento galios matuokliai Matavimo ribos: 2,0 μ Sv/h ... 11 mSv/h Paklaida $\pm (15 ... 30) \%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-142:2013
Ekspozicinės dozės ir dozės galios matuokliai Matavimo ribos: 1,0 μ R 180 μ R/h ... 1,0 R/h Paklaida $\pm (15 ... 25) \%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-144:2013
Individualūs dozimetrai Matavimo ribos: 10 μ Sv ... 10 mSv 2,0 μ Sv/h ... 11 mSv/h Paklaida $\pm (10 ... 25) \%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-147:2013
Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklis RadEye B20, RadEye B20-ER ir dozės galios matuoklis RadEye PRD Matavimo ribos Dozės galia 2,0 μ Sv/h ... 11 mSv/h, Paklaida $\pm 30 \%$ Paviršinė tarša: 10 Bq ... 10 kBq, Paklaida $\pm 25 \%$	Metrologinė patikra	PM 120229395-02:2012

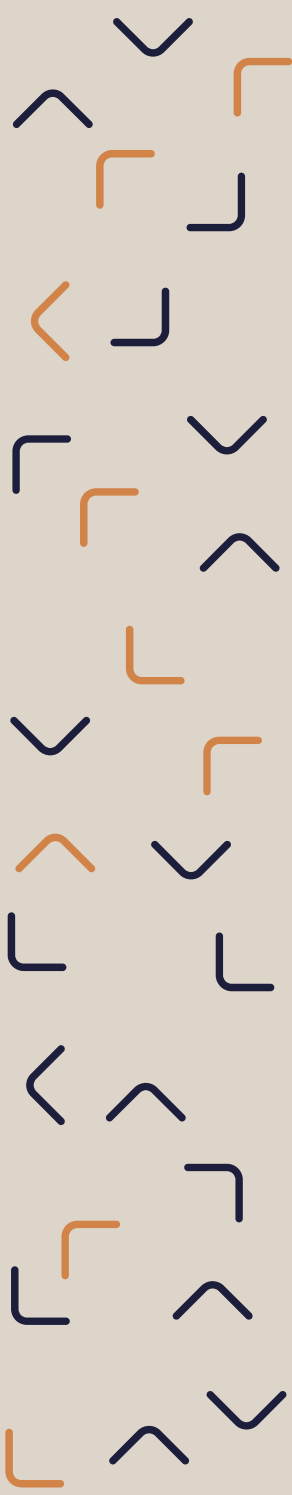


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Paviršinės taršos matuokliai Matavimo ribos 10 Bq ... 10 kBq Paklaida: ± (20 ... 45) %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-148:2014
Radiacinės taršos matuoklis AN/VDR-2 Oro kermos galia (0,001 ... 10) mGy/h ± 20 %	Metrologinė patikra	PM 120229395-07:2013
Dozimetrinė aplinkos stebėjimo sistema SARA AGS711X Aplinkos dozės ekvivalento galia 0,001µSv/h iki 100mSv/h ± 15 %	Metrologinė patikra	PM 120229395-04:2014
Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga) veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 41 Vilnius		
Analoginiai tachografai	Periodinė patikra	PM 2022939-43-98, PM 2022939-87-2000 (Reglamentas 165/2014/ES (1 priedas. VI sk.,3 p.)
Skaitmeniniai tachografai	Periodinė patikra	DTCO 1381 tikrinimo ir programavimo instrukcija, patvirtinta 2007-04-06 VMT direktoriaus įsakymu Nr.V-22 "Dėl DTCO 1381 tikrinimo ir programavimo instrukcijos pripažinimo tinkama skaitmeninių tachografų patikrai atlikti" Reglamentas 165/2014/ES (Reglamento 3821/85/EEB IB priedo VI sk. 2 p., 3 p., 4 p.)
Skaitmeniniai (išmanieji) tachografai	Periodinė patikra	SPM 111634747-02:2019 (pakeitimas Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023-08-17 įsakymu Nr.11V-136-(1.2) Reglamentas 165/2014/ES (Reglamento 2016/799/ES I C priedo 6 sk. 6.2 p., 6.3 p., 6.4 p.); Reglamentas 2021/1228/ES
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida ± 2 % Išmatuoto laiko paklaida ± 0,2 %	Periodinė patikra	BPM 120229395-90:2016


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Elektroninės svarstyklės I tikslumo klasė – iki 10 kg II tikslumo klasė – iki 100 kg III, IIII tikslumo klasė – iki 20 000 kg	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Mechaninės prekinės svarstyklės matavimo ribos iki 10 t III , IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000
Automobilių svarstyklės matavimo ribos iki 60 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės (sumuojančiosios bunkerių svarstyklės) iki 3000 kg, ≥ 0,2 tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-97:2006
Automatinės pavienių produktų svarstyklės iki 3000 kg Neautomatiniame svėrimo režime XI ir Y(I), XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) klasė Automatiniame svėrimo režime (XI ... XIII), Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006
Automatinės nepertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės $Q_{\max}=1000 \text{ t/h}$ ≥ 0,5 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-99:2006
Automatinės fasavimo svarstyklės Fasuotės masė iki 3000 kg, ≥ 0,5 tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-111:2006
Judančių transporto priemonių svėrimo sistema CROSS WIM, maksimali leidžiamoji dinaminio svėrimo paklaida, nustatant ašių apkrovą, $\leq \pm 8 \%$, nustatant bendrą (suminę) automobilio masę $\leq \pm$ 5 %, automobilio aukščio ir pločio matavimo leidžiamoji paklaida $\leq$ $\pm 0,3 \text{ m}$, automobilio ilgio matavimo leidžiamoji paklaida, prik- lausomai nuo automobilio ilgio ir greičio, nuo $\leq \pm (1,0 \text{ m} \dots 16,2 \text{ m})$.	Metrologinė patikra	SPM 164282613-02:2017 (skirta periodinei patikrai atlikti) SPM 164282613-02:2017 (skirta pirminei ir neeilinei patikrai atlikti)
Vandens skaitikliai atviriems kanalams su Paršalio, Venturi, Khafagi-Venturi, Palmer_Bowlus latakais arba su stačiakampėmis ar trikampėmis užtvankomis Debito matavimo neapibrėžtis $\geq \pm 2,5 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-80:2004
Ultragarsinis skysčio kiekio skaitiklis atviriems kanalams LMA-01 (50 ... 1000) mm $\pm 2 \text{ mm}$ Skysčio kiekio skaičiavimo paklaida $\pm 1,5 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 3268601-12:2001 Pakeitimas 1
Nuotekų kiekio skaitiklis SNU100 lygio matavimo paklaida $\pm 2 \text{ mm}$ $\pm 0,3 \%$ nuo maksimalios matavimo ribos	Metrologinė patikra	PM 165707056-08:2013

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Matavimo liniuotės (0,5 ... 5,0) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-48:2010 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Medžiagų ilgio matavimo priemonės Tikslumo klasė I, II, III matavimo ribos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-140:2013
Ilgio matavimo priemonės medienos ir žemės naudmenų matavimui (0 ... 100) m pirminei patikrai $\pm (c+1,5+L)$ mm periodinei patikrai $\pm 2(c+1,5+L)$ L- matuojamasis ilgis, m c=1 mm strypinėms kelių dalių kitoms c=0	Metrologinė patikra	BPM 8871101-116:2007 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Metrolazdės (0...5) m paklaida ± 1 mm ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-06:2013
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (0 ... 200) m tikslumo klasė. I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-20:2010 Pakeitimas 1
Žerglės (0 ... 1,0) m $\pm (0,5 ... 10) \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-115:2007
Automatiniai skysčio lygio talpyklose matuokliai matavimo ribos (0 ... 4) m, ≥ 1 t. kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-46:2005
Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai (0...10) m paklaida $\geq \pm 1,5$ mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-118:2007 Pakeitimas 1
Sietai akutės 20 μ m - 125 mm Paklaida $\geq \pm 2,3$ μ m	Metrologinė patikra	BPM 8871101-126:2013 Pakeitimas 1
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo standai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Rastų matavimo sistema: L - (0,50 – 30) m, ± 10 mm, D - (20 – 1500) mm, ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm V–80 mm $\leq D \leq 140$ mm, $\pm (200/D) \%$ ir $D > 140$ mm, $\pm 1,5 \%$, rastų grupės paklaida $\pm 1 \%$, D – rasto skersmuo, mm, V – rasto tūris, %	Metrologinė patikra	PM 30005224-01:2005 PM 1195058-08:2012 PM 132442337-01:2014
Rastų matavimo sistema Logeye301D „Microtec“ Skersmuo (50...1200) mm Paklaida ± 2 mm, vidutinė paklaida ± 1 mm Ilgis (1000...6500) mm Paklaida ± 20 mm, vidutinė paklaida ± 10 mm	Metrologinė patikra	SPM 111950581-03:2023


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Rąstų matavimo sistema CT log „Microtec Skersmuo (10...650) mm Paklaida ±10 mm Ilgis (1100...6000) mm Paklaida ±1 %	Metrologinė patikra	SPM 111950581-02:2023
Skaitmeniniai gylmačiai automobilinių padangų protektoriaus rašto gyliui matuoti Matavimų ribos ~ 25 mm Paklaida ≥ ± 0,02 mm	Metrologinė patikra	BPM 140216494-151:2014
Slankmačiai (skaitmeniniai slankmačiai, slankmačiai su nonijaus skale ir slankmačiai su apskritąja skale) matavimo ribos (0 ... 2000) mm paklaida ±ΔL,mm * *nurodyta gamintojo techniniuose dokumentuose	Metrologinė patikra	BPM 120229395-156:2018
Replinis įžeminimo varžos matuoklis 4200: srovė (0 mA iki 31,5 A), leidžiamoji paklaida ± 2 %; varža (0 ... 599) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 224501371-07:2006
Elektros tinklų matavimo sistemos UNITEST EURO EXPERT: varža (0 ... 2000) MΩ, leidžiamoji paklaida ± 2 %; įtampa (100 ... 440) V, leidžiamoji paklaida ± 2 %; dažnis 50 Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 %	Metrologinė patikra	PM 2022939-07-1999
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTST 61557: įtampa (2 ... 440) V, leidžiamoji paklaida ± 2 % srovė (0 ... 200) A, leidžiamoji paklaida ± 5 % varža (0 ... 1000) MΩ, leidžiamoji paklaida ≥ ± 2 %	Metrologinė patikra	PM 3264128-27:2002
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MACROTEST HT 5035: įtampa (0 ... 460) V, leidžiamoji paklaida ± 3 % dažnis (47,0 ... 63,6) Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % varža (0,01 ... 1999) MΩ, leidžiamoji paklaida ≥ ± 2 %; varža (0 ... 1999) Ω, leidžiamoji paklaida ± 5 %	Metrologinė patikra	PM 2563935-12:2003
Analoginiai ommetrai: varža (0,01Ω iki 1GΩ), leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,1%	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002
Fazė – nulio kontūro impedanso matuoklis METREL MI 3122 Kintama įtampa (0...550)V, leidžiamoji paklaida ± 2 %; Įnulinimo kontūro varža (0,0...99,9)Ω, , leidžiamoji paklaida ± 5 %; Įnulinimo kontūro varža (100Ω...9,99kΩ), leidžiamoji paklaida ± 10 %;	Metrologinė patikra	PM 135896117-06:2013
Srovės replės analoginės:	Metrologinė patikra	BPM 8871101-72:2002

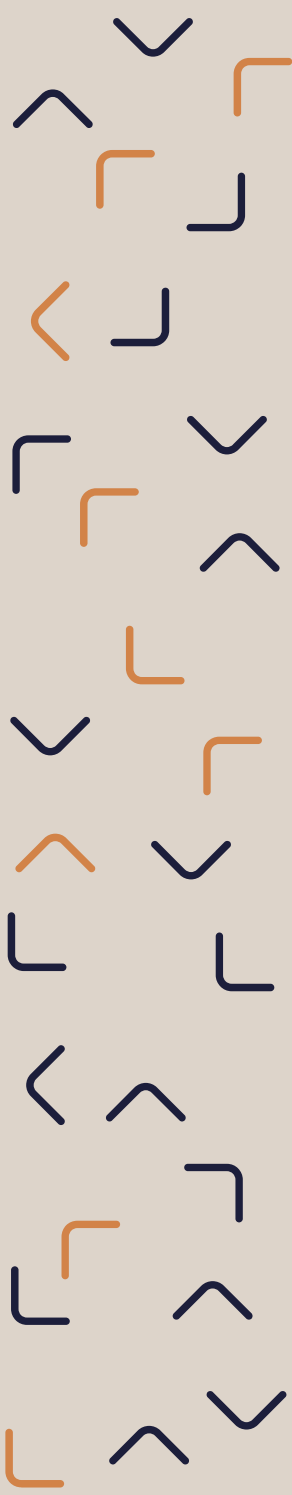


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
srovė kintama (0 ... 1000) A prie (10 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) ir (0 ... 200) A prie (65 Hz ≤ f ≤ 440 Hz), leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,0 %		
Įžeminimo varžos matavimo replės C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415: srovė (1 mA iki 29,99 A), leidžiamoji paklaida ± 2,5 %; varža (0,1 ... 600) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 2301124-27:2001
Srovės transformatoriai: pirminė apvija (0,5 ... 3000)A, antrinė apvija 1 A ar 5 A, tikslumo kl. ≥ 0,1	Metrologinė patikra	BPM 8871101-03:2013
Izoliacijos varžos matuoklis Metrel TeraOhm 5kV Nuolatinė ir kintama įtampa (3 ... 600)V, leidžiamoji paklaida ±(3-5)%, nuo 3kΩ iki 5TΩ, leidžiamoji paklaida ±5%, nuo 0,2nF iki 50μF, leidžiamoji paklaida ±5%, bandymo įtampa (250 ... 5000)V, leidžiamoji paklaida ±3%.	Metrologinė patikra	PM 3264128-30:2002
Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės Izoliacijos varža (0 ... 2T Ω) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Įžeminimo varža (0 ... 400) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Specifinė grunto varža (0 ... 2000) kΩm didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,02·ρ) Ω Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža (0 ... 20) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,1 R) Ω Varža (trumpo jungimo, mikro/miliometro) (0 ... 999) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 R) Ω Varistoriaus įtampa (0 ... 1500 V) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) Ω Nuolatinė įtampa (0 ... 1050) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintama įtampa (0 ... 1000) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintamos srovės stipris (0 ... 1000) A didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 I) A Dažnis (15 ... 1200) Hz didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,001 f) Hz Talpis (0,01 ... 50) μF didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,15 C) μF	Metrologinė patikra	BPM 8871101-69:2014

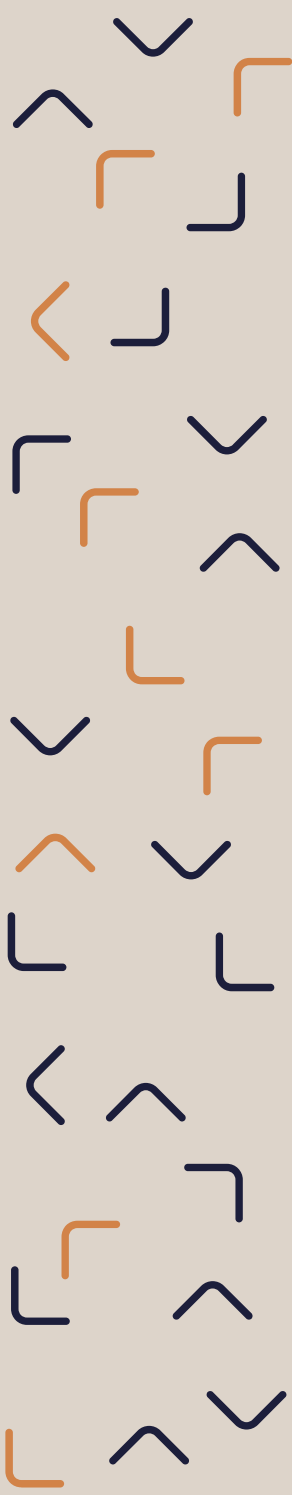

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Srovės replės skaitmeninės: įtampa (0 ... 1000) V leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,5 \%$ srovė (0 ... 1000) A, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,5 \%$ varža (0 Ω iki 400 M Ω), leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,1$ dažnis (0,5 Hz iki 10 MHz), leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,1 \%$ talpa (0,5 nF iki 40 mF), leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1,0 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-71:2002
METREL EUROTTEST MI 3102,MI3102H,MI3101,MI3105; MI3102H CL; MI3102H BT; MI3152H Varžos matavimas (0 ... 199,9) M $\Omega \pm 0,5\%$; (0 ... 999) M $\Omega \pm (2 - 10) \%$; (0 ... 19,99) $\Omega \pm 3 \%$; (20 ... 1999) $\Omega \pm 5 \%$ Įtampos matavimas (0 - 1200) V $\pm 3 \%$; (0 ... 500) V (50 Hz) $\pm 2 \%$ Srovės matavimas (0 ... 99,9) mA $\pm 5 \%$; (100 mA iki 19,99 A) $\pm 5\%$	Metrologinė patikra	PM 135896117-03:2010 SPM 135896117-02:2018
Spektrofotometrai (220...900) nm Paklaida $\pm 0,5$ nm ir didesnė (0...2) A Paklaida $\pm 0,002$ A ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005
Refraktometrai (1,32...1,7) n_d Paklaida $\pm 1 \times 10^{-4}$ n_d ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2003
Poliarimetrai (100...+100)°Z Paklaida $\pm 0,02$ °Z ir didesnė (-41...+41)° Paklaida $\pm 0,03$ ° ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-130:2008
Medienos drėgmėmačiai Drėgmės matavimo ribos (2 ... 100) %, leidžiamoji absoliutinė paklaida $\leq \pm 4 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008
Pieno analizatoriai (laktoskopai) (0...7) % riebalų Paklaida $\pm 1 \%$ ir didesnė (0...5) % baltymų Paklaida $\pm 1 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008

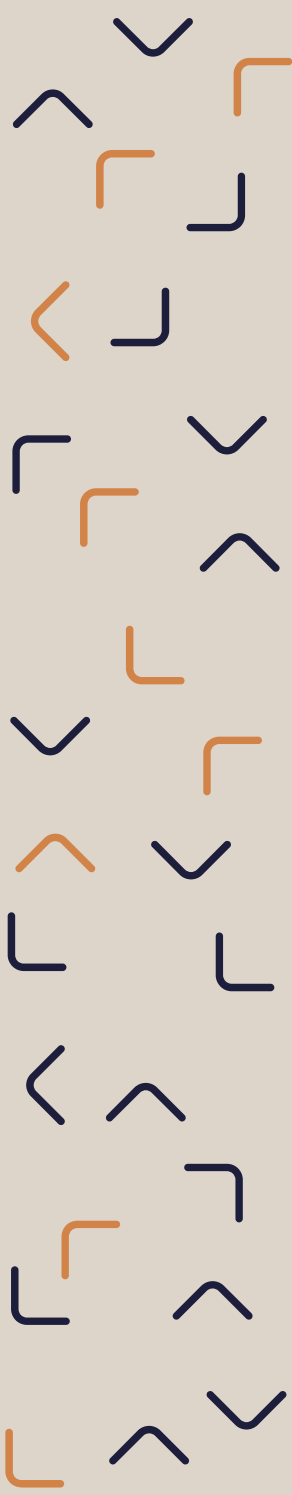


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai temperatūra (0 ... 55)°C, paklaida ± 0,3 % ir didesnė deguonies koncentracija (0 – 199,9) mg/l (0 ... 600) % O ₂ paklaida ± 0,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Alkoholio koncentracijos iškvėpiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo(0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126: β<0,4 mg/l ± ≤ (0,02...0,03) mg/l 0,4 mg/l ≤ β ≤ 2,0 mg/l ± ≤ (5...7,5)% β > 2,0 mg/l ± ≤ ((β/2-0,9)...((3-β)/4-1,35)) mg/l; pagal LST EN 15964: β ≤ 0,2 mg/l ± ≤ 0,02 mg/l β > 0,2 mg/l ± ≤ 10%	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
pH matuokliai (-2...12,45) pH Paklaida ± 0,01 pH ir didesnė (-1900...+1900) mV Paklaida ±1 mV ir didesnė 0,01 μS/cm...19,00 mS/cm Paklaida ±1,5 % ir didesnė (0...19) mg/l O ₂ Paklaida ± 1,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003
Psichrometrai: temperatūros matavimo ribos (-30 - +50) °C, leidžiamoji absoliutinė paklaida ≥ ± 0,1 °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 1 pakeitimas
Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės temperatūros matavimo ribos (-50 - +70) °C, leidžiamoji absoliutinė paklaida ≥ ± 0,1 °C santykinės drėgmės matavimo ribos (10...100)%, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 1 pakeitimas
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai (62...1000) s, paklaida ±1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014
Alyvos kolonėlės 1 - 100 dm ³ , tūrio matavimo paklaida ± 1,0 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-68:2002
Skystų produktų talpyklos: V _V = (3...200) m ³ , leidžiamoji paklaida ± 0,3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-96/1:2005 BPM 8871101-96/2:2005
Mažos talpyklos: V _V ≤ 35 m ³ leidžiamoji paklaida ± 0,5 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-109:2013
Techniniai saikikliai	Metrologinė patikra	BPM 8871101-34:2001

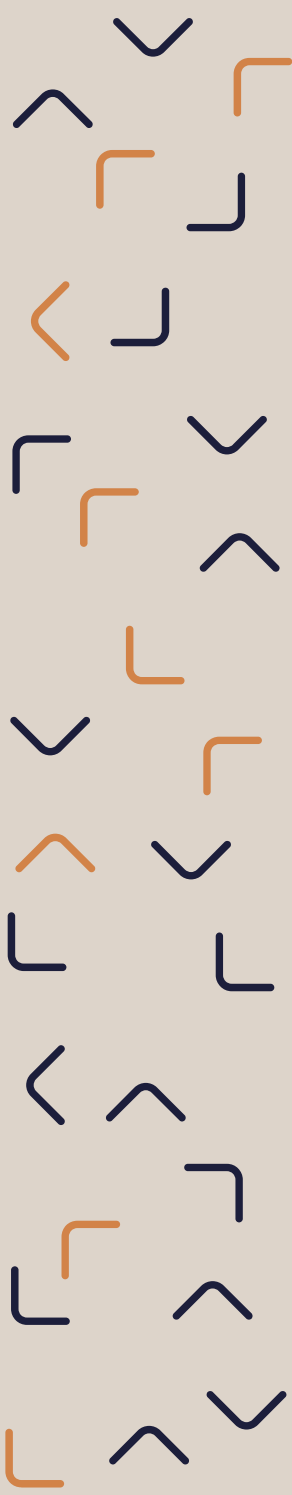

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
vienos reikšmės $V_v < 50000 \text{ dm}^3$ daugelio reikšmių $V_v < 2500 \text{ dm}^3$ 1 ir 2 tikslumo klasė		
Stikliniai butirometrai ribos (0 ... 40) % riebalų masės leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,01 \%$ $V = (0,125 \dots 2,252) \text{ ml}$ leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,00313 \text{ ml}$	Metrologinė patikra	PM 2022939-43:96
Stikliniai tūrio matavimo indai Būrėtės (1 ... 100) cm^3 , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Pipetės: (0,1 ... 200) cm^3 , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Kolbos (1 ... 5000) cm^3 , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Cilindrai (5... 2000) cm^3 , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Menzūros (50 ... 1000) cm^3 , paklaida $\geq \pm 2,5 \text{ cm}^3$ Mėgintuvėliai (5 ... 25) cm^3 , paklaida $\geq \pm 0,1 \text{ cm}^3$ Piknometrai (1 ... 100) cm^3 , paklaida $\geq \pm 0,1 \text{ cm}^3$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-17:2013
Laboratoriniai skysčių dozatoriai $V = (0,001 \dots 200) \text{ ml}$, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,2 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Dozatoriai alkoholiui: $V = (10 \dots 50) \text{ ml}$, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 3\%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-32:2001 1 keitimas
Tūrio dozavimo matai: $V_v = (0,02 \dots 5) \text{ dm}^3$, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 2 \text{ cm}^3$ arba $\geq \pm 3 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-33:2013
Plastikiniai tūrio indai: plastikiniai tūrio indai: $V_v = (0,005 \dots 5) \text{ dm}^3$, A ir B tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-131:2008
Svarsčiai, 1 mg iki 20 kg, $F_1 - M_3$ tikslumo klasės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-11:2008
Transporto priemonių greičio matavimo sistemos greičio matavimo ribos (20 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida $\leq \pm 1 \text{ km/h}$ iki 100 km/h $\leq \pm 1 \%$ virš 100 km/h $\leq \pm 2 \text{ km/h}$ iki 100 km/h $\leq \pm 2 \%$ virš 100 km/h $\leq \pm 3 \text{ km/h}$ iki 100 km/h $\leq \pm 3 \%$ virš 100 km/h	Metrologinė patikra	BPM 8871101-134:2013
Stikliniai skysčio termometrai (-50...+600) °C 1, 2 tikslumo klasė paklaida $\pm (0,1...15) \text{ °C}$	Metrologinė patikra	BPM 111950581-21:2024
Skaitmeniniai termometrai	Metrologinė patikra	BPM 8871101-22:2000

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
(-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,1$ °C		
Maksimalūs elektriniai termometrai + (32... 42) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,15$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-103:2006
Manometriniai termometrai (-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,5$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-23:2000
Termometrai su ciferblatu (-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1,0$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-101:2006
Infraraudonųjų spindulių termometrai (-30 - +300)°C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-128:2008
Temperatūros jutiklių poros (-65... + 650) °C, absoliutinė paklaida ± 2 °C; temperatūrų skirtumo paklaida $\pm (0,5 + 3Q_{min}/Q)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-73:2003
Varžiniai temperatūros jutikliai be keitiklių (-40 ... +300) °C, tiksl. kl. AA, A, B, C, D paklaidos $\pm(0,1+0,0017 t ...$ 1,2+0,12 t)°C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-51:2024
Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistema. Laiko paklaida ± 20 s per 7 paras	Metrologinė patikra	PM 12022395-18:2008 PM 111510685-08:2010 PM 160430566-10:2010 PM 302250087-03:2012 SPM 120229395-01:2022
Sekundmačiai mechaniniai iki 60 min, paklaida $\pm 0,8$ s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-60:2002
Sekundmačiai skaitmeniniai 9999,9 s, paklaida $\leq \pm 5$ s/parą	Metrologinė patikra	BPM 88711010-119:2007 Pakeitimas 2
Automobilių padangų slėgmačiai: kai $p \leq 0,4$ MPa, slėgio matavimo paklaida ($\pm$ kPa) 8, esant apl. temp. (15...25)°C; $0,5 \cdot (15 - t_{apl}) + 8$, kai ≤ 15 °C; $0,5 \cdot (t_{apl} - 25) + 8$, kai ≥ 25 °C; kai $p = (0,4...1,0)$ MPa, slėgio matavimo paklaida ($\pm$ kPa) 16, esant apl. temp. (15...25)°C; $0,5 \cdot (15 - t_{apl}) + 16$, kai ≤ 15 °C; $0,5 \cdot (t_{apl} - 25) + 16$, kai ≥ 25 °C; kai $p > 1,0$ MPa, slėgio matavimo paklaida ($\pm$ kPa) 25, esant apl. temp. (15...25)°C; $0,5 \cdot (15 - t_{apl}) + 25$, kai ≤ 15 °C; $0,5 \cdot (t_{apl} - 25) + 25$, kai ≥ 25 °C	Metrologinė patikra	BPM 120229395-40:2015

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai (į srovės signalą) matavimo ribos (-0,095 - 70,0) MPa, tikslumo klasė $\geq 0,075$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg $\pm 0,4$ kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C $\pm (3 \text{ arba } \leq 2\% \cdot p_i)$ mmHg $\pm (0,4 \text{ arba } \leq 2\% \cdot p_i)$ kPa didžiausia leidžiamoji histerezės paklaida: ± 4 mmHg $\pm 0,5$ kPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-05:2015
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg $\pm 0,4$ kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C $\pm (3 \text{ arba } \leq 2\% \cdot p_i)$ mmHg $\pm (0,4 \text{ arba } \leq 2\% \cdot p_i)$ kPa didžiausia vidutinė matavimo paklaida ± 5 mmHg $\pm 0,7$ kPa	Metrologinė patikra	BPM 8871101-27:2018
Barometrai Atmosferinio slėgio matavimo ribos (800-1060) hPa Slėgio matavimo paklaida ± 2 hPa Temperatūrinis koeficientas $\pm 0,16$ hPa /°C	Metrologinė patikra	PM 9074324-17:2000
Dinamometriniai raktai (1 -1000) Nm paklaida ± 4 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-105:2006
Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai (0-40) kN leidžiamoji paklaida pagamintiems iki 2008 m. $\pm 3\%$. Pagamintiems po 2008 m.: jėgai, mažesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida ± 100 N, didesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida $\pm 2\%$; kairės ir dešinės pusių neidentiško leidžiamoji paklaida $\pm 2,5\%$.	Metrologinė patikra	BPM 120229395-141:2013
Tonometrai (kontaktiniai mechaniniai intraokulinio slėgio matuokliai): ribos (0...127,5) mmHg paklaidos: svarelių masei ± 20 mg skalės rodmenims: 5" – ± 150 mg 10" – ± 200 mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-127:2008
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida ± 2 % Išmatuoto laiko paklaida $\pm 0,2$ %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016

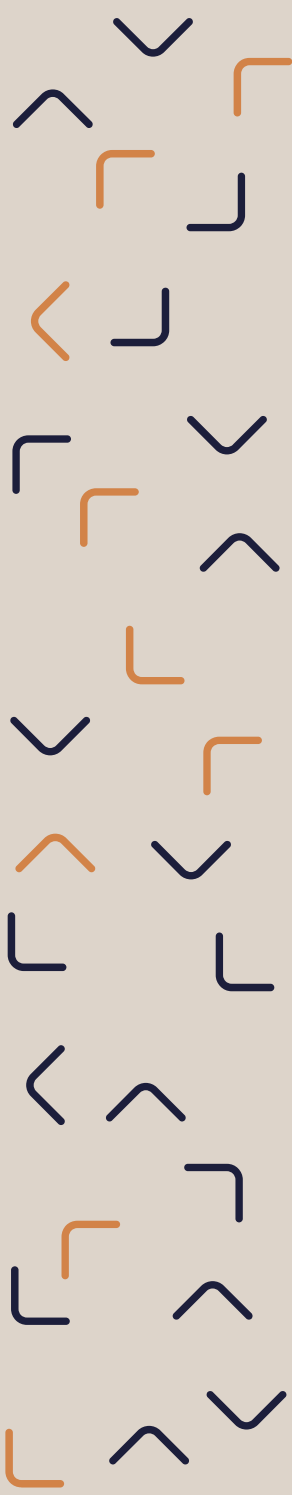

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Aukštaičių g. 43 Kaunas		
Šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...150) m³/h Karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...16) m³/h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav		
Šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,006...15) m³/h Karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,006...2.5) m³/h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023
Šilumos energijos skaitikliai srauto jutiklio sąlyginis skersmuo $D_s < 150$ mm tikslumo klasė 2; 4; 5 (OIML R75) 1; 2; 3 (OIML R75-1, EN 1434-1)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-45:2023
Ultragarsiniai vandens ir šilumos kiekio skaitikliai SKU-01, SKU-01M debito jutiklio sąlyginis skersmuo $D_s \geq 150$ mm, vandens kiekio leidžiamoji paklaida $\pm (2 + 0,02q_p/q) \%$; temperatūrų skirtumo $\pm 0,5$ K; šilumos kiekio $\pm (2,5+3/\Delta T+0,02q_p/q + Et) \%$	Metrologinė patikra	PM 3268601-02-97
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Velžio kelias 13, Panevėžys		
Šalto ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...10) m³/h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Baltupėnų g. 1, LT-78141Šiauliai		


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida $\pm 2\%$ Išmatuoto laiko paklaida $\pm 0,2\%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: J. Janonio g. 3 b, LT-35101 Panevėžys		
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida $\pm 2\%$ Išmatuoto laiko paklaida $\pm 0,2\%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016
Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
Elektroninės svarstyklės I tikslumo klasė – iki 10 kg II tikslumo klasė – iki 100 kg III, IIII tikslumo klasė – iki 20 000 kg	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Mechaninės prekinės svarstyklės matavimo ribos iki 10 t III , IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000
Automobilių svarstyklės matavimo ribos iki 60 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančiosios svarstyklės (0...5000) kg, $\geq 0,2$ tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-97:2006
Automatinės pavienių produktų svarstyklės iki 3000 kg Neautomatiniame svėrimo režime XI ir Y(I), XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) klasė Automatiniame svėrimo režime (XI ... XIII), Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006
Automatinės fasavimo svarstyklės Fasuotės masė iki 3000 kg, $\geq 0,5$ tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-111:2006
Skysčių ir dujų diafragminiai skaitikliai: vamzdžio skersmuo ($50 \geq D_{20} \leq 1000$) mm, diafragmos kiaurymės skersmuo $d_{20} \geq 12,5$ mm; slėgių ir temperatūros matavimo paklaidos pagal skaitiklio techninius dokumentus, debito matavimo paklaida nustatoma pirminės patikros metu	Metrologinė patikra	BPM 8871101-93:2006
Matavimo liniuotės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-48:2010

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
(0,5 ... 5,0) m tikslumo klasė I, II, III		Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (0 ... 200) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-20:2010 Pakeitimas 1
Metrolazdės (0...5) m paklaida ±1mm ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-06:2013
Medžiagų ilgio matavimo priemonės Tikslumo klasė I, II, III matavimo ribos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-140:2013
Ilgio matavimo priemonės medienos ir žemės naudmenų matavimui (0 ... 100) m pirminei patikrai ± (c+1,5+L) mm periodinei patikrai ± 2(c+1,5+L) L- matuojamasis ilgis, m c=1 mm strypinėms kelių dalių kitoms c=0	Metrologinė patikra	BPM 8871101-116:2007 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Skaitmeniniai gylmačiai automobilių padangų protektoriaus rašto gyliui matuoti Matavimų ribos ~ 25 mm Paklaida ≥ ± 0,02 mm	Metrologinė patikra	BPM 140216494-151:2014
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo standai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Žerglės (0 ... 1,0) m ± (0,5 ÷ 10) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-115:2007
Teodolitai αh=(0°...360°), αv=(-45°...+45 °) Vertikalaus kampo matavimo leidžiamoji paklaida ≥ 6 Horizontalaus kampo leidžiamoji paklaida ≥ 4,5.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-67:2002
Nivelyrai ±m _{km} aukščių skirtumo matavimo vidutinė kvadratinė paklaida, nurodyta nivelyro techniniuose dokumentuose	Metrologinė patikra	BPM 8871101-70:2007
Sietai akutės 20 μm iki 125 mm Paklaida ≥ ± 2,3 μm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-126:2013 Pakeitimas 1
Slankmačiai (skaitmeniniai slankmačiai, slankmačiai su nonijaus skale ir slankmačiai su apskritąja skale) matavimo ribos (0...2000) mm	Metrologinė patikra	BPM 120229395-156:2018

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
paklaida $\pm \Delta L, \text{mm}$ * *nurodyta gamintojo techniniuose dokumentuose		
Svarsčiai 10 mg...20 kg $F_1 - M_3$ tikslumo klasės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-11:2008
1 litro darbinės purkos paklaida $\pm 4 \text{ g/dm}^3$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-64:2002
Dinamometriniai raktai (1...3000) Nm leidžiamoji santykinė paklaida $\pm (4-6) \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-105:2006
Spyruokliniai dinamometrai (0...50) kN 1, 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-53:2002
Automobilių padangų slėgmačiai (0...1,8) MPa Paklaida $\pm 8 \text{ kPa}$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 120229395-40:2015
Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai (0...600) bar Išėjimo srovės kitimo intervalai (0...5), (0...20), (4...20) mA, paklaida $\pm 0,25 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistema. Laiko paklaida $\pm 20 \text{ s}$ per 7 paras	Metrologinė patikra	PM 111950581-09:2007 Pakeitimas 1 PM 12022395-18:2008, PM 111510685-08:2010, PM 160430566-10:2010 PM 302250087-03:2012
Stikliniai tūrio matavimo indai Biuretės (1 ... 100) cm^3 , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Pipetės: (0,1 ... 200) cm^3 , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Kolbos (1 ... 5000) cm^3 , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Cilindrai (5 ... 2000) cm^3 , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Menzūros (50 ... 1000) cm^3 , paklaida $\geq \pm 2,5 \text{ cm}^3$ Mėgintuvėliai (5 ... 25) cm^3 , paklaida $\geq \pm 0,1 \text{ cm}^3$ Piknometrai (1 ... 100) cm^3 , paklaida $\geq \pm 0,1 \text{ cm}^3$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-17:2013
Automatiniai skysčio lygio talpyklose matuokliai $H=(50...3500) \text{ mm}$, $UH = \pm 0,3 \text{ mm}$, $T = (-10...50) ^\circ\text{C}$, $UT = \pm 0,033 ^\circ\text{C}$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-46:2005
Degalų įpylimo kolonėlės $Q < 160 \text{ dm}^3/\text{min}$ tūrio matavimo paklaida $V \geq 2L \pm 0,5 \%$ $1 L \leq V < 2 L \pm 0,02 L$ $0,4 L \leq V < 1 L \pm 1 \%$	Metrologinė patikra	BPM 300637345-26:2024

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
Alyvos kolonėlės 1 ... 100 dm ³ Tūrio matavimo paklaida ± 1,0 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-68:2002
Suslėgtų gamtinių dujų išdavimo kolonėlės (1 ... 60) kg/min Pirminei patikrai ±1 % Periodinei patikrai ±2% ±0,5 cento	Metrologinė patikra	PM 300555909-05:2009
Suslėgtų gamtinių dujų išdavimo kolonėlės (1 ... 60) kg/min Pirminei patikrai ±1 % Periodinei patikrai ±2% ± 0,5 cento	Metrologinė patikra	PM 134614892-12:2008
Naftos produktų ir biodegalų matavimo sistemos (4...150) m ³ /h ± 0,5 % (-10...+50) °C ± 0,5 °C (770...900) kg/m ³ ±0,1 %	Metrologinė patikra	BPM 111955219-138:2011
Talpyklų komplekso apskaitos sistema HIMS tankio paklaida ±0,3% lygio paklaida ±1 mm temperatūros paklaida ± 0,5 °C masės paklaida ± 0,5 %	Metrologinė patikra	PM 1064889-09:2004
Skystų produktų talpyklos (Vardinė talpa 3 m ³ ...200 m ³), leidžiamoji paklaida ± 0,3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-96/1:2005
Skystų produktų talpyklos (Vardinė talpa 3 m ³ ...200 m ³), leidžiamoji paklaida ± 0,3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-96/2:2005
Vertikalios cilindrinės talpyklos (Be išorinės termoizoliacijos) leidžiamoji paklaida ± 0,2 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-84:2004
Vertikalios cilindrinės talpyklos (Su išorine termoizoliacija) leidžiamoji paklaida ± 0,2 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-85:2004
Autocisternos (0,6 m ³ ...35 m ³) leidžiamoji paklaida ± 0,5 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-95:2005
Mažos talpyklos: V _v ≤ 35 m ³ leidžiamoji paklaida ± 0,5 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-109:2013
Techniniai saikikliai vienos reikšmės V _v < 50000 dm ³ daugelio reikšmių V _v < 2500 dm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-34:2001

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
1 ir 2 tikslumo klasė		
Laivų talpyklos V _{min} -V _v Tūrio matavimo paklaida ±0,5 % Gradavimo neapibrėžtis ±0,3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-106:2006
Laboratoriniai skysčių dozatoriai V= (0,05 - 200) ml, leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,2 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Tūrio dozavimo matai (20...5000) ml paklaida ±3 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-33:2013
Tūrio matavimo indai: plastikiniai tūrio indai: V _v = (0,005...5) dm ³ , A ir B tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-131:2008
Stikliniai skysčio termometrai (-40...+600) °C 1, 2 tikslumo klasė paklaida ± (0,1...15) °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-21:2024
Manometriniai termometrai Matavimo ribos ir paklaida pagal tipo techninius dokumentus (-30... +600) °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-23:2000
Skaitmeniniai termometrai (-50...+600) °C, paklaida ±0,10° ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-22:2000
Maksimalūs elektriniai termometrai 35,5 °C ≤ t ≤ 42 °C, paklaida ±0,15 °C ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-103:2006
Termometrai su ciferblatu (-40... +600) °C, leidžiamoji paklaida ± 1,0 °C ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-101:2006
Keitiklis Pt 100/4-20 mA (-40...+500) °C, leidžiamoji paklaida ±0,08 mA	Metrologinė patikra	PM 1195589-63:2000
Infraraudonųjų spindulių termometrai (-30...+500) °C, leidžiamoji paklaida ≥1 °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-128:2008
Temperatūros savirašiai (-200...+1800) °C, leidžiamas parametro nuokrypis pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-150:2014
Termometrai CRR (-40...+120) °C, santykinė paklaida ±2%	Metrologinė patikra	PM 2303184-44:2002
Varžiniai temperatūros jutikliai be keitiklių (-30...+250) °C, tiksl. kl. B, C, D leidžiamoji absoliutinė paklaida nuo ±(0,3+0,005 t) °C iki ±(1,2+0,012 t) °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-51:2024

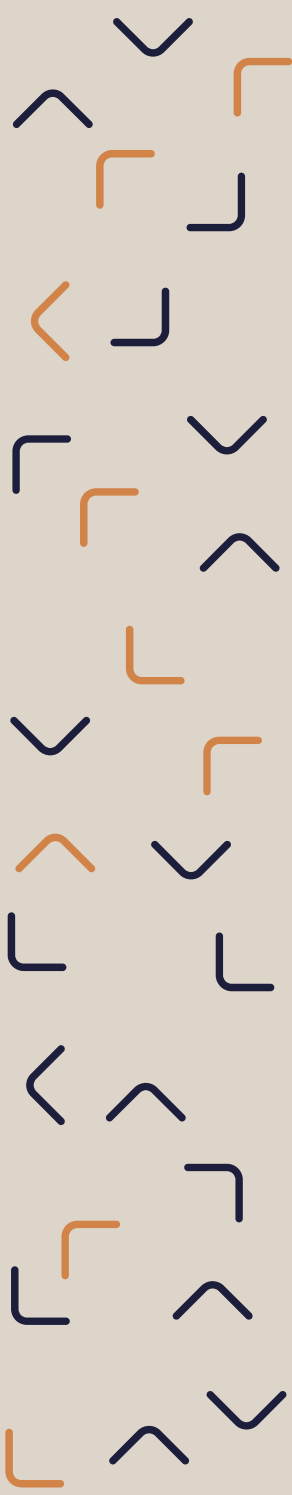


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
Videografiniai registratoriai: - temperatūros matavimo ribos, patikros metu nenaudojant jutiklių, (-270...+2495) °C, linearizavimo paklaida ±(0,02...0,22) °C, leidžiamoji matavimo paklaida pagal MP techninę dokumentaciją - nuolatinės įtampos matavimo ribos -(5 mV...50 V), leidžiamoji matavimo paklaida pagal MP techninę dokumentaciją - nuolatinės srovės matavimo ribos (4...20) mA, leidžiamoji matavimo paklaida pagal MP techninę dokumentaciją - varžos matavimo ribos (0...600) Ω, leidžiamoji matavimo paklaida pagal MP techninę dokumentaciją	Metrologinė patikra	PM 132442337-01:2010
Srovės replės skaitmeninės Įtampa (0...1000) V, paklaida ±0,5 % ir didesnė Srovė (0...1000) A, paklaida ±0,5 % ir didesnė Varža (0 Ω...400 MΩ), paklaida ±0,1 % ir didesnė Dažnis (0,5 Hz...10 MHz), paklaida ±0,1 % ir didesnė Talpa (0,5 nF...40 mF), paklaida ±1,0 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-71:2002
METREL EUROTTEST MI 3102,MI3102H,MI3101,MI3105 MI3102H CL MI3102H BT MI3152H Įtampa(0...500) V, paklaida ±2 % Varža (0...5,49) GΩ, paklaida ±2 % ir didesnė Srovė (0...19,99) A, paklaida ±5 % (50 Hz)	Metrologinė patikra	PM 135896117-03:2010 SPM 135896117-02:2018
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MACROTEST HT 5035 Įtampa (2...460) V, paklaida ±3 % ir didesnė Varža (0...1999) Ω, paklaida ±2 % ir didesnė (0,01...1999) MΩ,paklaida ±2 % ir didesnė Dažnis (47,0...63,6) Hz,paklaida ±0,1 %	Metrologinė patikra	PM 2563935-12:2003
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTTEST 61557 Įtampa(2...440) V, paklaida ±2 % Varža (0...1000) MΩ, paklaida ±2 % ir didesnė Srovė (0...200) mA, paklaida ±5 % Galia (0,01 μW...88,0 W), ±7 %	Metrologinė patikra	PM 3264128-27:2002
Izoliacijos varžos matuoklis METREL TERAOHM 5kV Įtampa(3...600) V, paklaida ±3 % Varža (3 kΩ...5 TΩ) , paklaida ±5 % Talpa (0,2 nF...50 μF), paklaida ±5 % Bandyimo įtampa (250÷1000) V, paklaida ±3 %	Metrologinė patikra	PM 3264128-30:2002
Fazė-nulis impedanso matuoklis METREL MI 3122 (0,1 Ω...9,99 kΩ),	Metrologinė patikra	PM 135896117-06:2013



Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
paklaida ±0,5 % ir didesnė (0...500)V, paklaida ±0,2 % Replinis įžeminimo varžos MATUOKLIS 4200 (0,0 Ω...599Ω)		
paklaida ±1,5 % ir didesnė 0 mA...31,5 A, paklaida ±2,0 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 224501371-07:2006
Įžeminimo varžos matavimo replės C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415 (0,1 Ω...600Ω), paklaida ±1,5 % ir didesnė 1mA...29,99A, paklaida ±2,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 2301124-27:2001
Analoginiai ommetrai (0,1 Ω...1 GΩ) paklaida ±0,1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002
Srovės transformatoriai (patikra naudojant CT Analyzer) Srovės stipris (A) (5...3 000) A/5A, 0,2 ir žemesnės tikslumo klasės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-03:2013
Skaitymeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės Izoliacijos varža (0 ... 1T Ω) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Įžeminimo varža (0 ... 400) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Specifinė grunto varža (0 ... 2000) kΩm didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,02·ρ) Ω Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža (0 ... 20) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,1 R) Ω Varža (trumpo jungimo, mikro/miliommetro) (0...999) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 R) Ω Varistoriaus įtampa (0 ...1500 V) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) Ω Nuolatinė įtampa (0 ... 1050) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintama įtampa (0 ... 1000) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintamos srovės stipris (0 ... 1000) A didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 I) A Dažnis (15 ...1200) Hz didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,001 f) Hz Talpis (0,01 ... 50) μF didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,15 C) μF	Metrologinė patikra	BPM 8871101-69:2014
Medienos drėgmėmačiai (2...100) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
Paklaida ≤ 4 %		
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai (62...1000) s Paklaida ±1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ±3 mmHg ±0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i) kPa didžiausia leidžiamoji histerezės paklaida: ± 4mmHg ±0,5kPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-05:2015
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ±3 mmHg ±0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i)kPa didžiausia vidutinė matavimo paklaida ±5mmHg ± 0,7kPa	Metrologinė patikra	BPM 8871101-27:2018
Tonometrai (Kontaktiniai mechaniniai intraokulinio slėgio matuokliai): ribos (0...127,5) mmHg paklaidos: svarelių masei ± 20mg skalės rodmenims: 5" – ±150mg 10" – ± 200mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-127:2008
Drėgmėmačiai (10...100) %, paklaida ±(3...5) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 Pakeitimas 1
Automatinė kapiliarinė viskozimetrinė sistema VISCO HOULLON ATREM („ISL“, Prancūzija) (1,183...2124) mm ² /s, paklaida ± (0,07...0,20) % (0,7648...0,8767) g/ml, paklaida ± 0,01 %	Metrologinė patikra	PM 4121649-62:2000
Tankio matavimo priemonės (830...890) kg/m ³ , paklaida ± (-0.16...0.24) kg/m ³ (0,029...0,16) kg/m ³ , paklaida ± (-0.28...0.020) kg/m ³ (0,058...0,86) kg/m ³ , paklaida ± (-0.27...-0.10) kg/m ³ (770...830) kg/m ³ , paklaida ± (0,058...0,13) kg/m ³ (980...1100) kg/m ³ , paklaida ± (0,35...0,91) kg/m ³ (890...950) kg/m ³ , paklaida ± (-0.18...0.45) kg/m ³ (0,0000...2,0000) g/cm ³ , paklaida ± (0,00004...0,00120) g/cm ³ (0,7648...0,8767) g/ml, paklaida ± 0,01 %.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-76:2003
Psichrometai (10...90) % paklaida ± (3... 5) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008
Alkoholio koncentracijos išskvepiamame ore matavimo priemonės,	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024

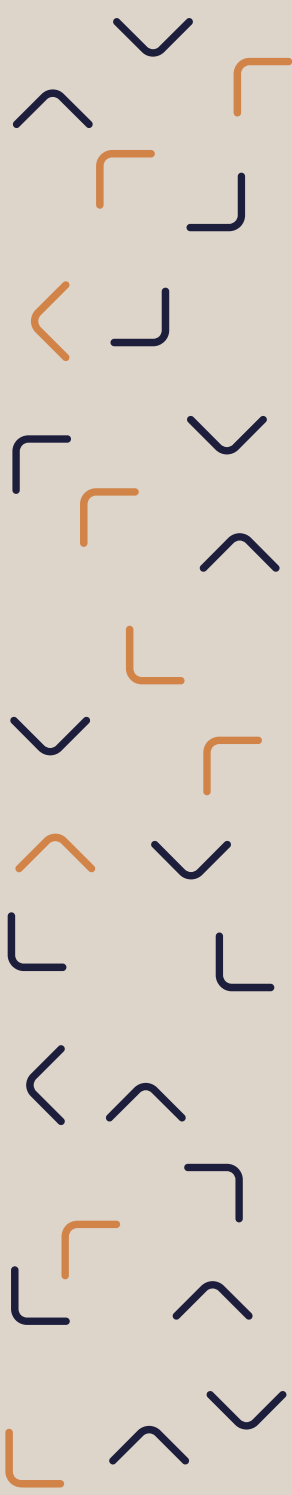

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo(0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126: β<0,4 mg/l ± ≤ (0,02...0,03) mg/l 0,4 mg/l ≤ β ≤ 2,0 mg/l ± ≤ (5...7,5)% β > 2,0 mg/l ± ≤((β/2-0,9)...((3·β)/4-1,35)) mg/l; pagal LST EN 15964: β ≤ 0,2 mg/l ± ≤ 0,02 mg/l β > 0,2 mg/l ± ≤ 10%		
Dyzelių variklių dūmingumo matavimo priemonės (dūmomačiai) (0...100) %, paklaida ± 1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-87:2004
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai temperatūra (0 ... 55)°C, paklaida ± 0,3 % ir didesnė deguonies koncentracija (0 – 199,9) mg/l (0 ... 600) % O ₂ paklaida ± 0,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Sprogių/degių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai (5...50) % ASR/AUR Paklaida ± 3 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-112:2006
Toksinių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai 5 tūr. ppm - 2 tūr. % Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-121:2007
pH matuokliai (-2...12,45) pH Paklaida ± 0,01 pH ir didesnė (-1900...+1900) mV Paklaida ±1 mV ir didesnė 0,01 μS/cm...19,00 mS/cm Paklaida ±1,5 % ir didesnė (0...19) mg/l O ₂ Paklaida ± 1,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003
Spektrofotometrai (220...900) nm Paklaida ± 0,5 nm ir didesnė (0...2) A Paklaida ± 0,002 A ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005
Refraktometrai (1,32...1,7) n _d Paklaida ±1×10 ⁻⁴ n _d ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2010
Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai (0 ... 5) tūr. % CO	Metrologinė patikra	BPM 8871101-79:2014

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Liepų g. 54 K4, LT-92106 Klaipėda		
Paklaida $\pm 5\%$ ir didesnė (0 ... 16) tūr. % CO ₂ Paklaida $\pm 5\%$ ir didesnė (0 ... 2000) ppm HC Paklaida $\pm 5\%$ ir didesnė (0 ... 21) tūr. % O ₂ Paklaida $\pm 5\%$ ir didesnė		
Taksometrai		
Nuvažiuto nuotolio fiksavimo paklaida $\pm 2\%$ Išmatuoto laiko paklaida $\pm 0,2\%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Klaipėdos regiono laboratorija, veiklos vykdymo vietos adresas: Ryšininkų g. 11, Klaipėda		
Šalto ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,012...30) m ³ /h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{\min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)		
	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas