

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.064

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**UAB „Nordic Metrology Science“
Kontrolės įstaiga**

LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: UAB „Nordic Metrology Science“
juridinio asmens kodas: 120229395

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2016-04-11**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-01-04**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-11-24**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-04-05**

Direktorė


DALIA BALEŽENTĖ

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu.
Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Nordic Metrology Science“ Kontrolės įstaiga, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietų adresai pateikiami prieš nurodant konkrečiu adresu vykdomą akredituotą veiklą

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS		
Elektroninės svarstyklės I tikslumo klasė – iki 10 kg II tikslumo klasė – iki 100 kg III, IIII tikslumo klasė – iki 20 000 kg	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Vagonų svarstyklės statiniame svėrimo režime matavimų ribos iki 200 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-09:2001 Pakeitimas 1 (galioja iki 2026-04-03)
Automobilių svarstyklės matavimo ribos iki 60 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Mechaninės prekinės svarstyklės matavimo ribos iki 10 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000
Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančiosios svarstyklės (0...5000) kg ≥ 0,2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-97:2006
Automatinės pavienių produktų svarstyklės iki 3000 kg Neautomatiniame svėrimo režime XI ir Y(I), XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) klasė Automatiniame svėrimo režime (XI ... XIII), Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Automatinės nepertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės $Q_{\max}=1000 \text{ t/h}$ $\geq 0,5$ tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-99:2006
Automatinės fasavimo svarstyklės Fasuotės masė iki 3000 kg, $\geq 0,5$ tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-111:2006
Svarsčiai 1mg ... 20 kg F_1, F_2, M_1, M_2 ir M_3 tikslumo klasė paklaida $\pm (0,006... 1000000) \text{ mg}$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-11:2008
JĖGOS MATAVIMO PRIEMONĖS		
Pedaliniai ergometrai, galia iki 500 W, sukimosi dažnis iki 130 aps/min, galios paklaida $\pm 3 \text{ W}$ iki 60 W, $\pm 5 \%$ virš 60 W, sukimosi dažnio paklaida $\pm 2 \text{ aps/min.}$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-100:2006
Dinamometriniai raktai (0,2 ... 3000) Nm, paklaida $\pm 4 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-105:2006
Spyruokliniai dinamometrai (0...500) kN 1, 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-53:2002
Stabdžių tikrinimo stendai (0 ... 6) kN $\pm 3 \%$ (0 ... 40) kN $\pm 2 \%$	Metrologinė patikra	BPM 120229395-141:2013
GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS		
Matavimo liniuotės (0,5 ... 5,0) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-48:2010 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (0 ... 200) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-20:2010 Pakeitimas 1
Metrolazdės (0...5) m paklaida $\pm 1 \text{ mm}$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-06:2013
Ilgio matavimo priemonės medienos ir žemės naudmenų matavimui (0 ... 100) m pirminei patikrai $\pm (c+1,5+L) \text{ mm}$ periodinei patikrai $\pm 2(c+1,5+L)$ L- matuojamasis ilgis, m c=1 mm strypinėms kelių dalių kitoms c=0	Metrologinė patikra	BPM 8871101-116:2007 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Medžiagų ilgio matavimo priemonės Tikslumo klasė I, II, III matavimo ribos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-140:2013
Žerglės (0 ... 1,0) m ± (0,5 ... 10) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-115:2007
Sietai akutės 20 μm - 125 μm Paklaida ≥ ± 2,3 μm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-126:2013 Pakeitimas 1 (galioja iki 2025-12-03)
Nivelyrai ±m _{km} aukščių skirtumo matavimo vidutinė kvadratinė paklaida, nurodyta nivelyro techniniuose dokumentuose	Metrologinė patikra	BPM 8871101-70:2007
Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai (0...10) m paklaida ≥ ± 1,5 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-118:2007 Pakeitimas 1
Skaitmeniniai gylmačiai automobilių padangų protektoriaus rašto gyliai matuoti Matavimų ribos ~ 25 mm Paklaida ≥ ± 0,02 mm	Metrologinė patikra	BPM 140216494-151:2014
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo standai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi paklaida ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS (TŪRIS, KIEKIS)		
Alyvos kolonėlės 1 - 100 dm ³ Tūrio matavimo paklaida ± 1,0 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-68:2002
Techniniai saikikliai vienos reikšmės Vv< 50000 dm ³ daugelio reikšmių Vv < 2500 dm ³ 1 ir 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-34:2001
Pieno tūrio matuokliai 10 dm ³ ± 0,05 dm ³ , 20 dm ³ ± 0,075 dm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-74:2003
Stikliniai tūrio matavimo indai Būrėtės (1 - 100) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Pipetės (0,1 - 200) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Kolbos (1 - 5000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Cilindrai (5- 2000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Menzūros (50 - 1000) cm ³ , paklaida ≥ ± 2,5 cm ³ Mėgintuvėliai (5 - 25) cm ³ , paklaida ≥ ± 0,1 cm ³ Piknometrai (1 - 100) cm ³ , paklaida ≥ ± 0,1 cm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-17:2013
Plastikiniai tūrio matavimo indai Talpa (0,005...5) dm ³ , tikslumo klasė A, B	Metrologinė patikra	BPM 8871101-131:2008


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Tūrio dozavimo matai: $V_v - (0,02 - 5) \text{ dm}^3$, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 2 \text{ cm}^3$ arba $\geq \pm 3 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-33:2013
Laboratoriniai skysčių dozatoriai $V = (0,001 - 200) \text{ ml}$, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,2 \%$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Vieno litro darbinės purkos, paklaida $\pm 4,0 \text{ g/dm}^3$	Metrologinė patikra	BPM 8871101-64:2002
FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS		
Areometrai Matavimo ribos: $(650 \dots 1840) \text{ kg/m}^3$ Paklaida $\pm 0,5$ padalos ir didesnė Matavimo ribos: $(0 \dots 105) \%$ tūrio % Paklaida $\pm 0,1$ tūrio % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-76:2003
Naftos densimetrai Matavimo ribos: $(0,71 \dots 1,63) \text{ g/cm}^3$ Paklaida $\pm 0,0001 \text{ g/cm}^3$ ir didesnė	Metrologinė patikra	Mažagabaritinio skaitmeninio skysčių tankio matuoklio Densimeter 921 Patikros metodika, patvirtinta 1996-01- 30
Medienos drėgmės matuokliai Matavimo ribos: $(7 \dots 60) \%$ Paklaida $\pm 0,2 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008
Grūdų drėgmės matuokliai Matavimo ribos: $(0 \dots 100) \%$ Paklaida $\pm 0,5 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-125:2008
Automatinis pliūpsnio temperatūros analizatorius FP 935 G Matavimo ribos: $(40 \dots 450) ^\circ\text{C}$ Paklaida $\pm 0,035 t_p$ ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 1067889-67:2000
Automatinė kapiliarinė viskozimetrinė sistema VISCO HOUILLON ATREM Matavimo ribos: $(3 \dots 2000) \text{ mm}^2/\text{s}$ Paklaida $\pm 0,5 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 4021649-62:2000 (galioja iki 2025-12-29)
Kietųjų dalelių analizatoriai Matavimo ribos: $(7 \dots 100) \%$ Paklaida $\pm 2 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-136:2010
Stikliniai butirometrai Matavimo ribos: $(0 \dots 40) \%$ riebalų Paklaida $\pm 0,5$ padalos ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 2022939-43-96
Pieno analizatoriai (laktoskopai) $(0 \dots 7) \%$ riebalų Paklaida $\pm 1 \%$ ir didesnė $(0 \dots 5) \%$ baltymų Paklaida $\pm 1 \%$ ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Alkoholio koncentracijos iškvėpiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo(0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126: $\beta < 0,4$ mg/l $\pm \leq (0,02...0,03)$ mg/l $0,4$ mg/l $\leq \beta \leq 2,0$ mg/l $\pm \leq (5...7,5)\%$ $\beta > 2,0$ mg/l $\pm \leq ((\beta/2-0,9)...((3\cdot\beta)/4-1,35))$ mg/l; pagal LST EN 15964: $\beta \leq 0,2$ mg/l $\pm \leq 0,02$ mg/l $\beta > 0,2$ mg/l $\pm \leq 10\%$	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
Dyzelių variklių dūmingumo matavimo priemonės (dūmomačiai) (0...100) %, paklaida ± 1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-87:2004
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai temperatūra (0 - 55)°C, paklaida $\pm 0,3$ % ir didesnė deguonies koncentracija (0 – 199,9) mg/l (0 - 600) % O ₂ , paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Automobilių išmetamųjų dujų analizatoriai (0 ... 5) tūr. % CO Paklaida ± 5 % ir didesnė (0 ... 16) tūr. % CO ₂ Paklaida ± 5 % ir didesnė (0 ... 2000) ppm HC Paklaida ± 5 % ir didesnė (0 ... 21) tūr. % O ₂ Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-79:2014
Sprogių/degių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai (5...50) % ASR/AUR Paklaida ± 3 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-112:2006 (galioja iki 2026-04-03)
Toksinių dujų matavimo sistemos ir signalizatoriai 5 tūr. ppm - 2 tūr. % Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-121:2007 (galioja iki 2026-04-03)
Nešiojami dujų analizatoriai EX-TEC GM4 Deguonies (O ₂) koncentracija. 0...25) tūrio % Paklaida 10 % arba $\pm 0,3$ tūrio %	Metrologinė patikra	PM 120059523-02:2014 (galioja iki 2026-04-03)
pH matuokliai (-2...12,45) pH Paklaida $\pm 0,01$ pH ir didesnė (-1900...+1900) mV Paklaida ± 1 mV ir didesnė 0,01 μ S/cm...19,00 mS/cm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Paklaida $\pm 1,5$ % ir didesnė (0...19) mg/l O ₂ Paklaida $\pm 1,5$ % ir didesnė		
Elektriniai aspiratoriai Matavimo ribos: (0,2...50) l/min Paklaida ± 5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 2022939-19-98
Rotametrai (plūdiniai debitmačiai) Oro (dujų) debito matavimo ribos (0,0 3- 1,2) m ³ /h Paklaida $\pm (2...10)$ %	Metrologinė patikra	BPM 111955219-146:2013
Automobilių stiklų šviesos pralaidumo matavimo prietaisai CL 176 RS (0...100) % Paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 122757637-10:2006
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai (62...1000) s Paklaida ± 1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014
OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS		
Liuksmetrai (5...1500) lx Paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-77:2014
Liepsniniai fotometrai PFM (0...160 mmol/l Na ⁺ (0...10) mmol/l K ⁺ Paklaida $\pm 0,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-157:2024
Fotoelektriniai kolorimetrai (0...100) % T Paklaida ± 1 % T ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 147146671-143:2013
Kietojo ir skystojo kuro kalorimetrai 40 000 ± 100 J/K Paklaida $\pm 0,1$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 111950581-158:2024
Poliarimetrai (100...+100)°Z Paklaida $\pm 0,02$ °Z ir didesnė (-41...+41)° Paklaida $\pm 0,03$ ° ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-130:2008
Refraktometrai (1,32...1,7) n _d Paklaida $\pm 1 \times 10^{-4}$ n _d ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2010
Spektrofotometrai (220...900) nm Paklaida $\pm 0,5$ nm ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005

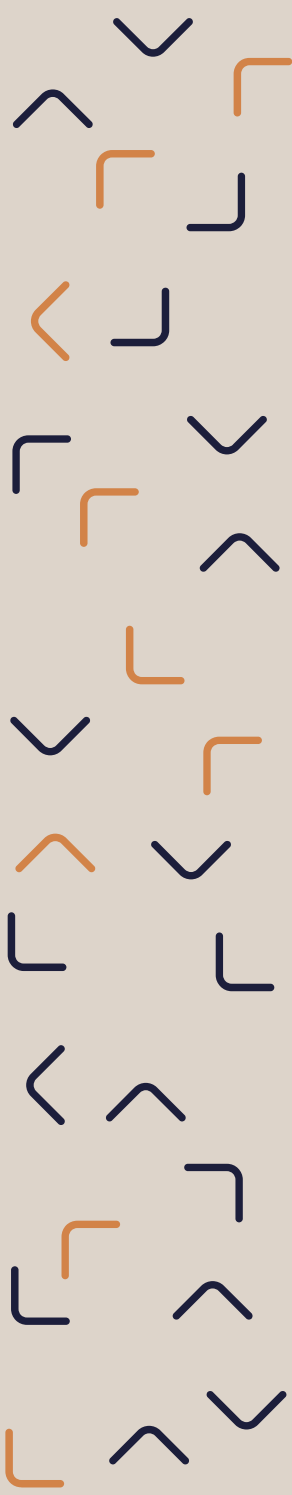


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
(0...2) A Paklaida ± 0,002 A ir didesnė		
TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS		
Stikliniai skysčio termometrai (-80...+600) °C 1, 2 tikslumo klasė paklaida ± (0,1...15) °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-21:2024
Skaitmeniniai termometrai (-80...+600)°C paklaidos pagal termometro techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 8871101-22:2000 (galioja iki 2026-01-15)
Manometriniai termometrai (0...300)°C tiksl. kl. 11,522,54	Metrologinė patikra	BPM 8871101-23:2000
Termometrai su ciferblatu (-80...+600)°C tiksl. kl. 12 paklaidos ±(2...10)°C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-101:2006
Maksimalūs elektriniai termometrai (32,0...42,0)°C tiksl. kl 1 2 paklaidos ±(0,15...0,4)°C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-103:2006 (galioja iki 2026-01-15)
Stikliniai skysčio tankio matuokliai (areometrų termometrai) (-25...+40)°C, paklaidos ±(0,1...0,5)°C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-76:2003 BPM 8871101-30:2001
Varžiniai temperatūros jutikliai (-50...+600)°C tiksl. kl. AA, A, B, C, D paklaidos ±(0,1+0,0017 t ...1,2+0,12 t)°C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-51:2024
Keitiklis Pt 100/4-20mA T _{min} ...T _{max} (priklausomai nuo keitiklio modifikacijos arba nurodytos ant pačių temperatūros keitiklių) paklaidos ±0,08mA	Metrologinė patikra	PM 1195589-63:2000
Infraraudonųjų spindulių termometrai (-50...1200) °C, leist.pakl. pagal termometro tech. dokumentacija	Metrologinė patikra	BPM 8871101-128:2008
Termoelektriniai temperatūros jutikliai (termoporos) (-40...1700)°C, leist. pakl. ±(1,0...2,5)°C nuo (-40...+333)°C ir ±(0,0025·t...0,0075·t) nuo (333...1700)°C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-52:2001
Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės (-50...70)°C, (2...100)% paklaidos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 Pakeitimas 1
Temperatūros savirašiai (-80...1600)°C Paklaidos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-150:2014

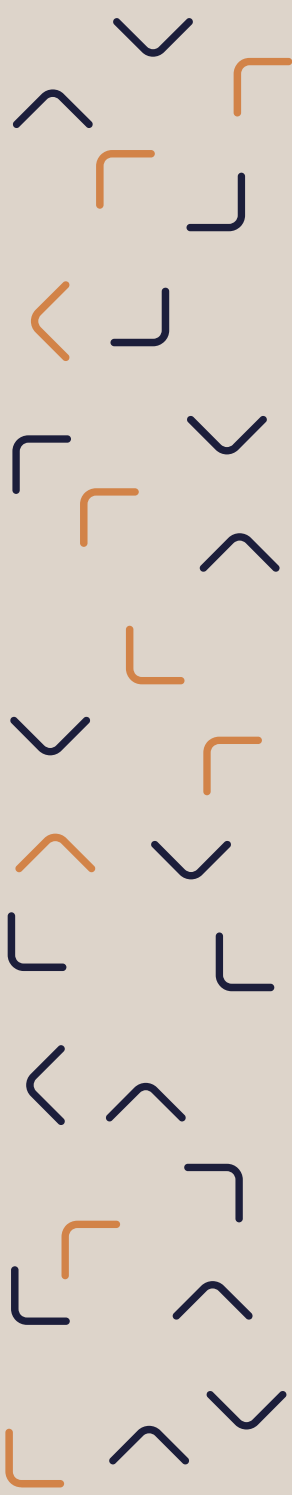


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS		
Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai: ribos (-0,1...60) MPa slėgio skirtumas <400 kPa tiksl. kl.: 0,1 0,2 0,25 0,5	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Automobilių padangų slėgmačiai: ribos (0...1,2) MPa paklaidos pirminei (periodinei) patikrai: ±8 (±10) kPa ≤ 0,4 MPa ±16 (±20) kPa (0,4...1,0) MPa ±25 (±31) kPa > 1,0 MPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-40:2015
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i) kPa didžiausia leidžiamoji histerezės paklaida: ± 4mmHg ±0,5kPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-05:2015
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ± 3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i)kPa didžiausia vidutinė matavimo paklaida ±5mmHg ± 0,7kPa	Metrologinė patikra	BPM 8871101-27:2018
Tonometrai (Kontaktiniai mechaniniai intraokulinio slėgio matuokliai): ribos (0...127,5) mmHg paklaidos: svarelių masei ± 20 mg skalės rodmenims: 5" – ±150mg 10" – ±200mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-127:2008
ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS		
Srovės matavimo replės skaitmeninės Įtampa (0...1000) V, leidžiamoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau Srovė (0... 1000) A, leidžiamoji paklaida ± 0,6 % ir daugiau Varža (0 Ω... 400 MΩ) , leidžiamoji paklaida ± 0,1 % ir daugiau Dažnis (0,5 Hz... 10 MHz), paklaida ± 0,1 % ir daugiau Elektrinė talpa (0,5 nF...40 mF) paklaida ± 1 % ir daugiau	Metrologinė patikra	BPM 8871101-71:2002
Srovės matavimo replės analoginės Įtampa (0...100) V, prie f=(10...40) Hz leistinoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau	Metrologinė patikra	BPM 8871101-72:2002

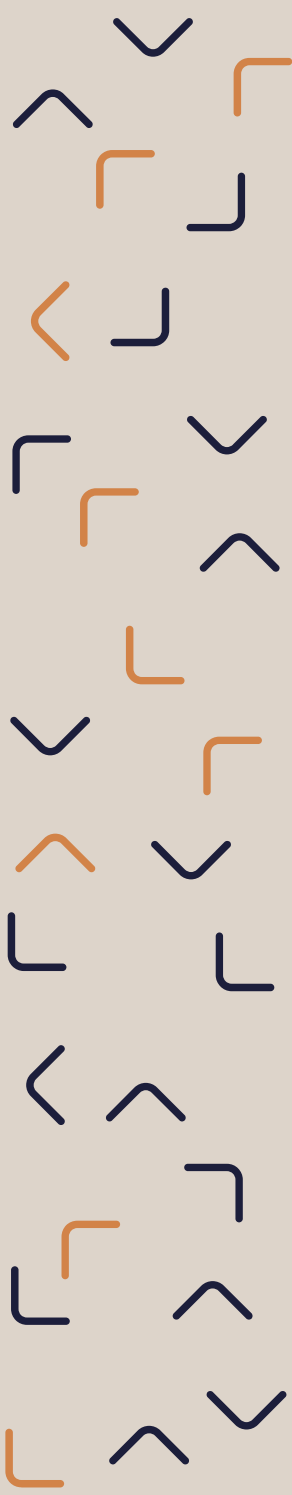

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Įtampa (0...1000) V, prie f=(40...1 000) Hz, leistinoji paklaida ± 0,5 % ir daugiau Srovė (0... 1000) A, prie f=(10...65) Hz paklaida ± 1 % ir daugiau Varža (0 Ω... 40 MΩ) , leistinoji paklaida ± 0,6 % ir daugiau		
Srovės matavimo transformatoriai I ₁ = (0,5 ... 50000) A I ₂ = (1...5) A Tikslumo klasė – 0,1 0,2 0,2S 0,5 0,5S 1 3 10 5P 5PR 10P 10PR	Metrologinė patikra	BPM 8871101-03:2013
Įtampų transformatoriai Matavimo ribos: U ₁ (5...35) kV, t. kl. (0,2...6P) U ₁ (35...245) kV, t. kl. (0,5...6P)	Metrologinė patikra	BPM 8871101-63:2014 Pakeitimas 1
Elektros energijos skaitikliai Įtampa (30 ... 300) V Srovė 1 mA iki 120 A Fazės kampas iki 360° Energija P; Q Tikslumas (0,2S; 0,5S; 0,5; 1; 1S, 2; 3) ir A, B, C klasės	Metrologinė patikra	BPM 303038190-14:2024
Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės Izoliacijos varža (0 ... 1T Ω) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Įžeminimo varža (0 ... 400) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω Specifinė grunto varža (0 ... 2000) kΩm didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,02·ρ) Ω Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža (0 ... 20) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,1 R) Ω Varža (trumpo jungimo, mikro/miliometro) (0 ... 99) kΩ didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 R) Ω Varistoriaus įtampa (0 1500 V) didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) Ω Nuolatinė įtampa (0 ... 1050) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintama įtampa (0 ... 1000) V didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V Kintamos srovės stipris (0 ... 1000) A didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 I) A Dažnis (15 ...1200) Hz didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,001 f) Hz Talpis (0,01 ... 50) μF didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,15 C) μF	Metrologinė patikra	BPM 8871101-69:2014 (galioja iki 2026-01-02)
Analoginiai ommetrai, Matavimo ribos nuo 0,01 Ω iki 1 GΩ	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002

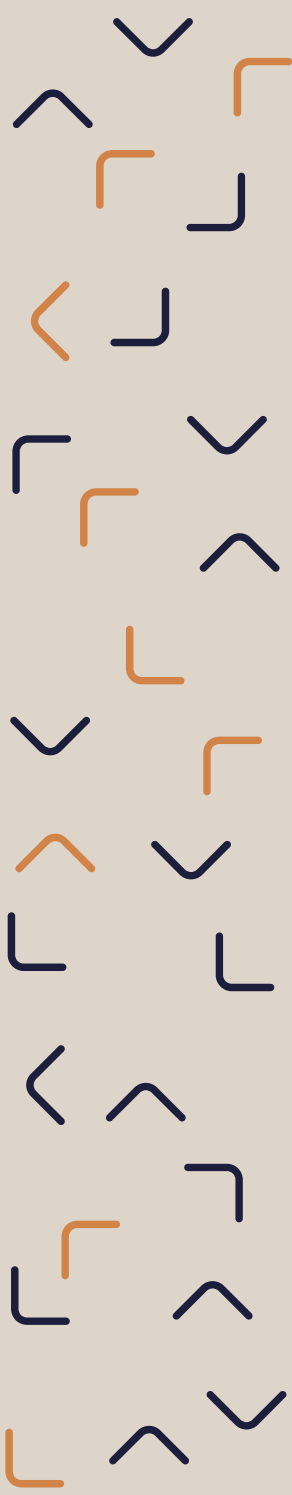

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Leidžiamoji paklaida ± 0,015 % ir daugiau		
Izoliacijos varžos matuoklis METREL TeraOhm 5 kV nuolatinė įtampa (3 iki 600)V leidžiamoji paklaida ± 3,0 % kintama įtampa (3 iki 600)V leidžiamoji paklaida ± 3,0 % bandymo įtampa (250 iki 5000)V leidžiamoji paklaida ± 3,0 % talpa (0,2 nF iki 50 µF) leidžiamoji paklaida ± 5,0 % varža (3 kΩ iki 5 TΩ) leidžiamoji paklaida ± 5,0 % ir daugiau	Metrologinė patikra	PM 3264128-30:2002 (galioja iki 2026-01-02)
Elektros tinklų matavimo sistemos UNITEST EURO EXPERT varža (0 ... 2000) MΩ leidžiamoji paklaida ± 2 % įtampa (100 ... 440) V leidžiamoji paklaida ± 2 % dažnis 50 Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % ir daugiau	Metrologinė patikra	PM 2022939-07-1999 (galioja iki 2026-01-02)
Daugiafunkciniai instaliacijos matuokliai METREL EUROTEST MI 3102, MI3102H, MI3101, MI3105, MI3102H CL, MI3102H BT, MI3152H Varžos matavimas (0 ... 199,9) MΩ ± 0,5% (0 - 999) MΩ ± (2 ... 10) % (0 - 19,99) Ω ± 3 %; (20 ... 1999) Ω ± 5 % Įtampos matavimas (0 ... 1200) V ± 3 % (0 - 500) V (50 Hz) ± 2 % Srovės matavimas (0 ... 99,9) mA ± 5 % (100 mA - 19,99 A) ± 5%	Metrologinė patikra	PM 135896117-03:2010 (galioja iki 2026-01-02) SPM 135896117-02:2018 (galioja iki 2026-01-02)
Fazė – nulio kontūro impedanso matuoklis METREL MI 3122 Kintama įtampa (0 ... 550) V leidžiamoji paklaida ± 2 % Įnulinimo kontūro varža (0,0 ... 99,9)Ω leidžiamoji paklaida ± 5 % Įnulinimo kontūro varža (100Ω...9,99kΩ) leidžiamoji paklaida ± 10 %;	Metrologinė patikra	PM 135896117-06:2013 (galioja iki 2026-01-02)
Replinis įžeminimo varžos matuoklis 4200 KYORITSU srovė (0 mA iki 31,5 A), leidžiamoji paklaida ± 2 %; varža (0 ... 599) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 224501371-07:2006 (galioja iki 2026-01-02)
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis Metrel Eurotest 61557 METREL įtampa (2 ...440) V	Metrologinė patikra	PM 3264128-27:2002 (galioja iki 2026-01-02)

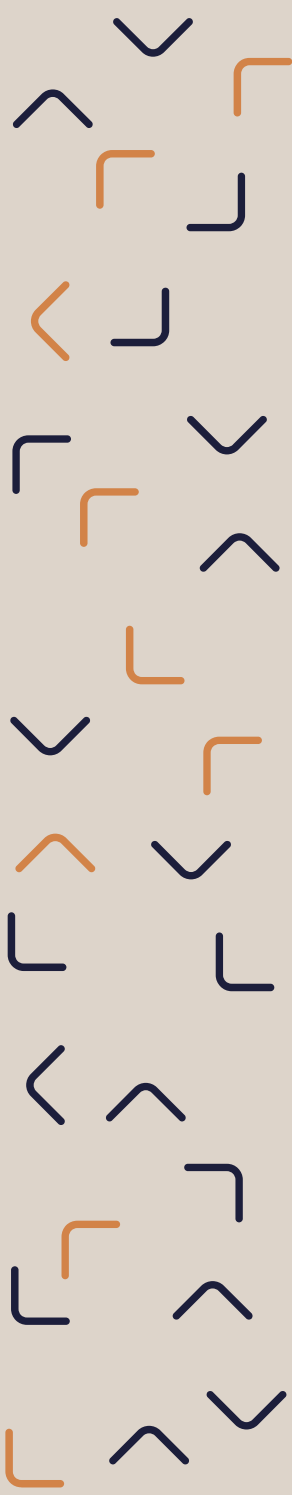


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
leidžiamoji paklaida ± 2 % dažnis (15,3 ... 99,9) Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % varža (0,02 ... 1999) Ω leidžiamoji paklaida ± 2 % varža (0,02 ... 1999) MΩ leidžiamoji paklaida ± 2 % ir daugiau		
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis Macrotest HT5035 įtampa (100 ... 460) V leidžiamoji paklaida ± 3 % dažnis (47,0 ... 63,6) Hz leidžiamoji paklaida ± 0,1 % varža (0 ... 1999) Ω leidžiamoji paklaida ± 5 % varža (0,01 ... 1999) MΩ leidžiamoji paklaida ± 2 % ir daugiau	Metrologinė patikra	PM 2563935-12:2003 (galioja iki 2026-01-02)
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MPI-525	Metrologinė patikra	PM 302127533-05:2014 (galioja iki 2026-01-02)
LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS		
Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistema. Laiko paklaida ± 20 s per 7 paras	Metrologinė patikra	PM 120229395-18:2008 (galioja iki 2026-03-21) PM 111950581-09:2007 Pakeitimas1 (galioja iki 2026-03-21) PM 302250087-03:2012 (galioja iki 2026-03-21) PM 160430566-10:2010 (galioja iki 2026-03-21) SPM 120229395-01:2022 (galioja iki 2026-03-21)
Lazerinis transporto priemonių greičio matavimo prietaisas SL 700" (8... 350) km/h, leidžiamoji paklaida ± 2km/h	Metrologinė patikra	PM 121793694-08-2006 (galioja iki 2026-01-10)
Radiolokacinė transporto priemonių judėjimo greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo sistema BERKUT-VIZA Dažnis – 24,15 GHz, leidžiamas nuokrypis ± 0,1GHz Greitis (20 ... 250) Km/h, leidžiamoji paklaida ±1km/h – stacionariame režime ±2km/h – patruliniame režime	Metrologinė patikra	PM 244913310-02:2007 (galioja iki 2026-01-10)
Radiolokacinis transporto priemonių greičio matavimo ir vaizdo fiksavimo prietaisas VIZIR Dažnis – 24,15 GHz, I leidžiamas nuokrypis ± 0,1GHz Greitis (20 .. 250) km/h, leidžiamoji paklaida	Metrologinė patikra	PM 244913310-07:2008 (galioja iki 2026-01-10)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
± 1km/h – stacionariame režime ± 2km/h – patruliniame režime		
Greičio matavimo sistema TraffiSection VECTOR P2P Greičio matavimo paklaida kelyje: kai greitis mažesnis nei 100 km/h ± 2 km/h, kai greitis didesnis nei 100 km/h ± 2%.	Metrologinė patikra	SPM 120229395-03:2019 (galioja iki 2026-01-04)
Lazerinis greičio matuoklis TruCAM greičio matavimo paklaida ± 2 km/h atstumo matavimo paklaida ± 15 cm greičio matavimo ribos (0...320) km/h transporto priemonės nuotolio matavimo minimalus atstumas greičio režime 15,25 m	Metrologinė patikra	PM 120229395-07:2010 (galioja iki 2026-01-10)
Lazerinis greičio matavimo prietaisas TRAFFIPATROL greičio matavimo paklaida ± 2 km, kai greitis mažesnis nei 100 km/h ± 2 %, kai greitis didesnis nei 100 km/h greičio matavimo ribos (0...300) km/h atstumo galimybė matuojant greitį (10...500) m	Metrologinė patikra	PM 2029072-80:1999 (galioja iki 2026-01-10)
Lazerinis greičio matavimo prietaisas TRAFFIPATROL XR greičio matavimo paklaida ± 2 km/h, kai kai greitis mažesnis nei 100 km/h ± 2 %, kai greitis didesnis nei 100 km/h greičio matavimo ribos (0 ... 320) km/h transporto priemonės nuotolio matavimo ribos (10 ... 1500) m	Metrologinė patikra	PM 110736215-04:2007 (galioja iki 2026-01-10)
Lazerinis greičio matuoklis TruSpeed greičio matavimo paklaida ± 2 km/h atstumo matavimo paklaida ± 0,015 m greičio matavimo ribos (0 ... 322) km/h	Metrologinė patikra	PM 120229395-01:2009 (galioja iki 2026-01-10)
Transporto priemonių greičio matavimo sistemos greičio matavimo ribos (20 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida ≤± 1 km/h iki 100 km/h ≤± 1 % virš 100 km/h ≤± 2 km/h iki 100 km/h ≤± 2 % virš 100 km/h ≤± 3 km/h iki 100 km/h ≤± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	BPM 8871101-134:2013 (galioja iki 2026-01-10)
Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema „PASScam“ (1 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida ≤± 3 km/h iki 100 km/h ≤± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	SPM 302664120-01:2018 (galioja iki 2026-01-04)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Transporto priemonių vidutinio greičio matavimo sistema „PASScam” 1 ... 299) km/h greičio matavimo paklaida (kai naudojamas rankinis stebimo ruožo ilgio įvedimas) ≤± 2 km/h iki 100 km/h ≤± 2 % virš 100 km/h greičio matavimo paklaida (kai stebimo ruožo ilgis nustatomas automatiškai) ≤± 3 km/h iki 100 km/h ≤± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	SPM 121793694-01:2020 (galioja iki 2026-01-04)
Greičio matavimo sistema ITC EYE (1 ... 300) km/h ± 2 km/h	Metrologinė patikra	SPM 120229395-01:2017 (galioja iki 2026-01-10)
Greičio matavimo sistema ITC EYE Compact 300 (1 - 300) km/h ± 2 km/h	Metrologinė patikra	SPM 120229395-06:2019 (galioja iki 2026-01-10)
Sekundmačiai mechaniniai iki 60 min, paklaida ± 0,8 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-60:2002
Sekundmačiai skaitmeniniai 9999,9 s paklaida ≤ ± 5 s/parą	Metrologinė patikra	BPM 8871101-119:2007 Pakeitimas 1
AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS MATAVIMŲ PRIEMONĖS		
Vibracijos matuokliai: vibracijos pagreitis (0,01 ... 5000) m/s ² leistinoji paklaida ± 3 % ir didesnė.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-113:2007
Akustinių triukšmų matuoklis 41AM, Nor118, garso lygis (30 ... 130) dB dažnis 20 Hz ... 20 kHz leistinoji paklaida ± 0,6 dB ir didesnė.	Metrologinė patikra	PM 1001192-02:2004 Pakeitimas 1
Garso lygio matuokliai t.kl. 1, 2: garso lygis (20 ... 140) dB dažnis 20 Hz ... 20 kHz leistinoji paklaida ± 0,6 dB ir didesnė.	Metrologinė patikra	BPM 120229395:155:2017
Pastatų akustinių charakteristikų sistema Nor1516 30 ... 130 dB 20 ... 16 000 Hz	Metrologinė patikra	PM 11153734-01:2008
Garso tono audiometrai 30 ... 130 dB 20 ... 8 000 Hz	Metrologinė patikra	BPM 221906050-139:2013
JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS MATAVIMO PRIEMONĖS		
Aplinkos dozės ekvivalento galios matuokliai Matavimo ribos: 2,0 μSv/h ... 11 mSv/h	Metrologinė patikra	BPM 120229395-142:2013

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius		
Paklaida ± (15 ... 30) %		
Ekspozicinės dozės ir dozės galios matuokliai Matavimo ribos: 1,0 μR 180 μR/h ... 1,0 R/h Paklaida ± (15 ...25) %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-144:2013
Individualūs dozimetrai Matavimo ribos: 10 μSv ... 10 mSv 2,0 μSv/h ... 11 mSv/h Paklaida ± (10 ... 25) %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-147:2013
Dozės galios ir paviršinės taršos matuoklis RadEye B20, RadEye B20-ER ir dozės galios matuoklis RadEye PRD Matavimo ribos Dozės galia 2,0 μSv/h ... 11 mSv/h, Paklaida ±30 % Paviršinė tarša: 10 Bq ...10 kBq, Paklaida ±25 %	Metrologinė patikra	PM 120229395-02:2012
Paviršinės taršos matuokliai Matavimo ribos 10 Bq ... 10 kBq Paklaida: ± (20 ... 45) %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-148:2014
Radiacinės taršos matuoklis AN/VDR-2 Oro kermos galia (0,001 ... 10) mGy/h ± 20 %	Metrologinė patikra	PM 120229395-07:2013
Dozimetrinė aplinkos stebėjimo sistema SARA AGS711X Aplinkos dozės ekvivalento galia 0,001μSv/h iki 100mSv/h ± 15 %	Metrologinė patikra	PM 120229395-04:2014


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Vilniaus regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga) veiklos vykdymo vietos adresas: Dariaus ir Girėno g. 41 Vilnius		
Analoginiai tachografai	Periodinė patikra	PM 2022939-43-98, PM 2022939-87-2000 (Reglamentas 165/2014/ES (1 priedas. VI sk.,3 p.)
Skaitmeniniai tachografai	Periodinė patikra	DTCO 1381 tikrinimo ir programavimo instrukcija, patvirtinta 2007-04-06 VMT direktoriaus įsakymu Nr.V-22 "Dėl DTCO

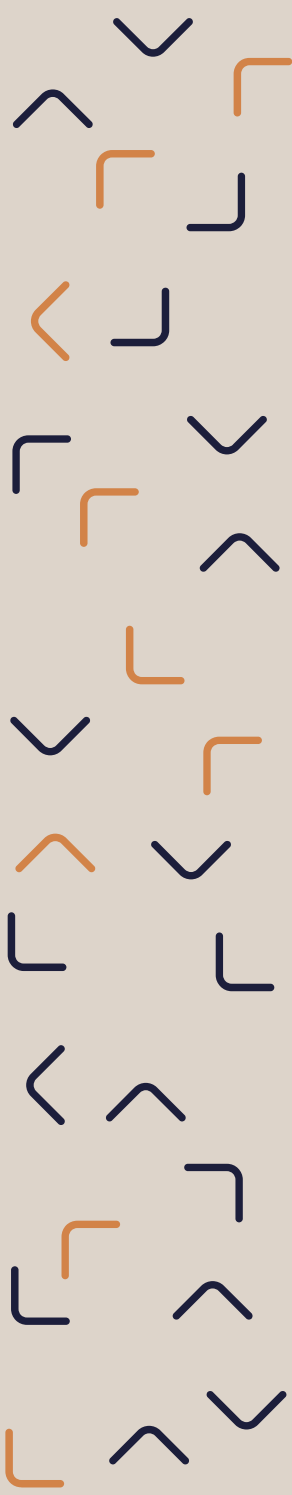

		1381 tikrinimo ir programavimo instrukcijos pripažinimo tinkama skaitmeninių tachografų patikrai atlikti" Reglamentas 165/2014/ES (Reglamento 3821/85/EEB IB priedo VI sk. 2 p., 3 p., 4 p.) SPM 111634747-02:2019 (pakeitimas Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023-08-17 įsakymu Nr.11V-136-(1.2) Reglamentas 165/2014/ES (Reglamento 2016/799/ES I C priedo 6 sk. 6.2 p., 6.3 p., 6.4 p.); Reglamentas 2021/1228/ES
Skaitmeniniai (išmanieji) tachografai	Periodinė patikra	
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida ± 2 % Išmatuoto laiko paklaida ± 0,2 %	Periodinė patikra	BPM 120229395-90:2016


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
MASĖS MATAVIMO PRIEMONĖS		
Elektroninės svarstyklės I tikslumo klasė – iki 10 kg II tikslumo klasė – iki 100 kg III, IIII tikslumo klasė – iki 20 000 kg	Metrologinė patikra	BPM 111950581-08:2024
Mechaninės prekinės svarstyklės matavimo ribos iki 10 t III , IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-19:2000
Automobilių svarstyklės matavimo ribos iki 60 t III, IIII tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-38:2001 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės (sumuojančiosios bunkerio svarstyklės) iki 3000 kg, ≥ 0,2 tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-97:2006
Automatinės pavienių produktų svarstyklės iki 3000 kg Neautomatiniame svėrimo režime XI ir Y(I), XII ir Y(II), XIII ir Y(a), XIII ir Y(b) klasė Automatiniame svėrimo režime (XI ... XIII), Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-98:2006
Automatinės nepertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės Q _{max} =1000 t/h ≥ 0,5 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-99:2006
Automatinės fasavimo svarstyklės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-111:2006

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Fasuotės masė iki 3000 kg, ≥ 0,5 tikslumo kl.		
Judančių transporto priemonių svėrimo sistema CROSS WIM, maksimali leidžiamoji dinaminio svėrimo paklaida, nustatant ašių apkrovą, ≤ ± 8 %, nustatant bendrą (suminę) automobilio masę ≤ ± 5 %, automobilio aukščio ir pločio matavimo leidžiamoji paklaida ≤ ± 0,3 m, automobilio ilgio matavimo leidžiamoji paklaida, prik- lausomai nuo automobilio ilgio ir greičio, nuo ≤ ± (1,0 m ... 16,2 m).	Metrologinė patikra	SPM 164282613-02:2017 (skirta periodinei patikrai atlikti) SPM 164282613-02:2017 (skirta pirminei ir nēilinei patikrai atlikti) Pakeitimas 1
Svarsčiai, 1 mg iki 20 kg, F ₁ - M ₃ tikslumo klasės	Metrologinė patikra	BPM 8871101-11:2008
Tonometrų (kontaktiniai mechaniniai intraokulinio slėgio matuokliai): ribos (0...127,5) mmHg paklaidos: svarelių masei ± 20 mg skalės rodmenims: 5" – ±150mg 10" – ±200mg	Metrologinė patikra	BPM 8871101-127:2008
Jėgos matavimo priemonės		
Dinamometriniai raktai (1 -1000) Nm paklaida ± 4 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-105:2006
Automobilių stabdžių parametrų matavimo stendai (0-40) kN leidžiamoji paklaida pagamintiems iki 2008 m. ±3%. Pagamintiems po 2008 m.: jėgai, mažesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida ± 100 N, didesnei kaip 5000 N leidžiamoji paklaida ± 2%; kairės ir dešinės pusių neidentišškumo leidžiamoji paklaida ±2,5%.	Metrologinė patikra	BPM 120229395-141:2013
GEOMETRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS		
Matavimo liniuotės (0,5 ... 5,0) m tikslumo klasė I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-48:2010 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Medžiagų ilgio matavimo priemonės Tikslumo klasė I, II, III matavimo ribos pagal tipo techninius dokumentus	Metrologinė patikra	BPM 147146671-140:2013
Ilgio matavimo priemonės medienos ir žemės naudmenų matavimui (0 ... 100) m pirminei patikrai ± (c+1,5+L) mm periodinei patikrai ± 2(c+1,5+L) L- matuojamasis ilgis, m c=1 mm strypinėms kelių dalių kitoms c=0	Metrologinė patikra	BPM 8871101-116:2007 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2

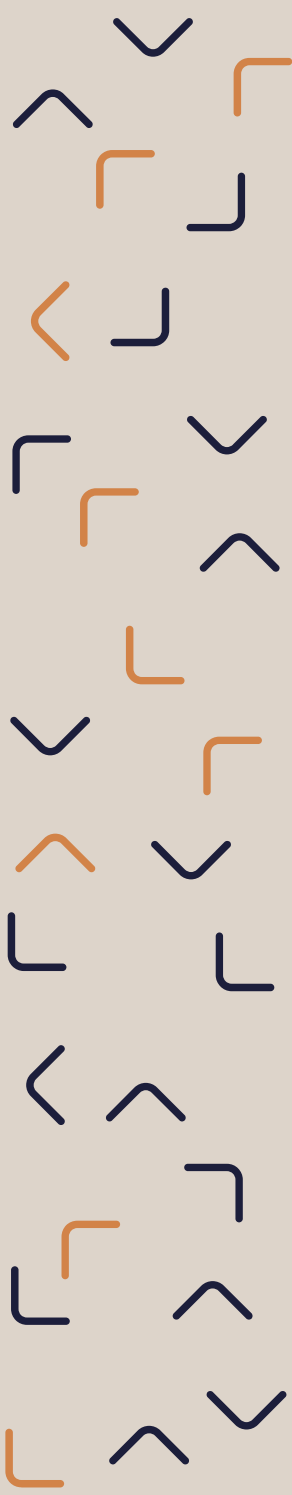


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Metrolazdės (0...5) m paklaida ±1mm ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-06:2013
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (0 ... 200) m tikslumo klasė. I, II, III	Metrologinė patikra	BPM 8871101-20:2010 Pakeitimas 1
Žerglės (0 ... 1,0) m ± (0,5 ... 10) %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-115:2007
Automatiniai skysčio lygio talpyklose matuokliai matavimo ribos (0 ... 4) m, ≥ 1 t. kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-46:2005
Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai (0...10) m paklaida ≥ ± 1,5 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-118:2007 Pakeitimas 1
Sietai akutės 20 μm - 125 mm Paklaida ≥ ± 2,3 μm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-126:2013 Pakeitimas 1 (galioja iki 2025-12-03)
Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo stendai Optinės sistemos ir skalės tarpusavio orientavimo paklaida horizontalia kryptimi ir vertikalia kryptimi ± 3 mm	Metrologinė patikra	BPM 8871101-102:2006 Pakeitimas 1 Pakeitimas 2
Rastų matavimo sistema: L - (0,50 – 30) m, ±10 mm, D - (20 – 1500) mm, ±1 mm, ±2 mm, ±3 mm , ±5 mm V–80 mm ≤ D≤140 mm, ±(200/D)% ir D>140 mm, ±1,5%, rastų grupės paklaida ± 1 %, D – rasto skersmuo, mm, V – rasto tūris, %	Metrologinė patikra	PM 30005224-01:2005 PM 1195058-08:2012 PM 132442337-01:2014
Rastų matavimo sistema Logeye301D „Microtec“ Skersmuo (50...1200) mm Paklaida ±2 mm, vidutinė paklaida ±1 mm Ilgis (1000...6500) mm Paklaida ±20 mm, vidutinė paklaida ±10 mm	Metrologinė patikra	SPM 111950581-03:2023
Rastų matavimo sistema CT log „Microtec“ Skersmuo (10...650) mm Paklaida ±10 mm Ilgis (1100...6000) mm Paklaida ±1 %	Metrologinė patikra	SPM 111950581-02:2023
Skaitmeniniai gylmačiai automobilių padangų protektoriaus rašto gyliui matuoti Matavimų ribos ~ 25 mm Paklaida ≥ ± 0,02 mm	Metrologinė patikra	BPM 140216494-151:2014
ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS		
Replinis įžeminimo varžos matuoklis 4200: srovė (0 mA iki 31,5 A), leidžiamoji paklaida ± 2 %; varža (0 ... 599) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 224501371-07:2006 (galioja iki 2026-01-02)

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Elektros tinklų matavimo sistemos UNITEST EURO EXPERT: varža (0 ... 2000) MΩ, leidžiamoji paklaida ± 2 %; įtampa (100 ... 440) V, leidžiamoji paklaida ± 2 %; dažnis 50 Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 %	Metrologinė patikra	PM 2022939-07-1999 (galioja iki 2026-01-02)
Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTST 61557: įtampa (2 ... 440) V, leidžiamoji paklaida ± 2 % srovė (0 ... 200) A, leidžiamoji paklaida ± 5 % varža (0 ... 1000) MΩ, leidžiamoji paklaida ≥ ± 2 %	Metrologinė patikra	PM 3264128-27:2002 (galioja iki 2026-01-02)
Skaitmeninis instaliacijos parametrų matuoklis MACROTEST HT 5035: įtampa (0 ... 460) V, leidžiamoji paklaida ± 3 % dažnis (47,0 ... 63,6) Hz, leidžiamoji paklaida ± 0,1 % varža (0,01 ... 1999) MΩ, leidžiamoji paklaida ≥ ± 2 %; varža (0 ... 1999) Ω, leidžiamoji paklaida ± 5 %	Metrologinė patikra	PM 2563935-12:2003 (galioja iki 2026-01-02)
Analoginiai ommetrai: varža (0,01Ω iki 1GΩ), leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,1%	Metrologinė patikra	BPM 8871101-66:2002
Fazė – nulis kontūro impedanso matuoklis METREL MI 3122 Kintama įtampa (0...550)V, leidžiamoji paklaida ± 2 %; Įnulinimo kontūro varža (0,0...99,9)Ω, , leidžiamoji paklaida ± 5 %; Įnulinimo kontūro varža (100Ω...9,99kΩ), leidžiamoji paklaida ± 10 %;	Metrologinė patikra	PM 135896117-06:2013 (galioja iki 2026-01-02)
Srovės replės analoginės: srovė kintama (0 ... 1000) A prie (10 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) ir (0 ... 200) A prie (65 Hz ≤ f ≤ 440 Hz), leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,0 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-72:2002
Įžeminimo varžos matavimo replės C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415: srovė (1 mA iki 29,99 A), leidžiamoji paklaida ± 2,5 %; varža (0,1 ... 600) Ω, leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,5 %	Metrologinė patikra	PM 2301124-27:2001 (galioja iki 2026-01-02)
Srovės transformatoriai: pirminė apvija (0,5 ... 3000)A, antrinė apvija 1 A ar 5 A, tikslumo kl. ≥ 0,1	Metrologinė patikra	BPM 8871101-03:2013
Izoliacijos varžos matuoklis Metrel TeraOhm 5kV Nuolatinė ir kintama įtampa (3 ... 600)V, leidžiamoji paklaida ±(3-5)%, nuo3kΩ iki 5TΩ, leidžiamoji paklaida ±5%, nuo 0,2nF iki 50μF, leidžiamoji paklaida ±5%,	Metrologinė patikra	PM 3264128-30:2002 (galioja iki 2026-01-02)

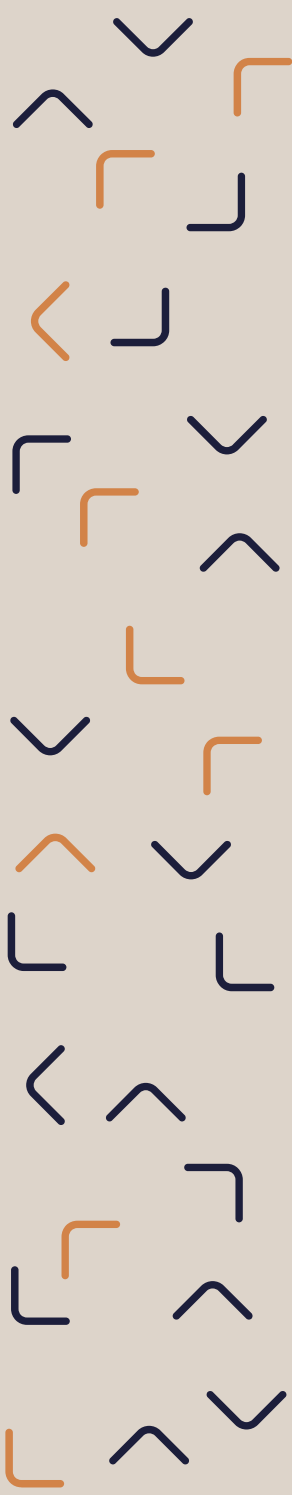


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
bandymo įtampa (250 ... 5000)V, leidžiamoji paklaida ±3%.		
Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės		
Izoliacijos varža (0 ... 2T Ω)		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω		
Įžeminimo varža (0 ... 400) kΩ		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,2 R) Ω		
Specifinė grunto varža (0 ... 2000) kΩm		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,02·ρ) Ω		
Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža (0 ... 20) kΩ		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,1 R) Ω		
Varža (trumpo jungimo, mikro/miliometro) (0 ... 999) kΩ		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 R) Ω		
Varistoriaus įtampa (0 ...1500 V)	Metrologinė patikra	BPM 8871101-69:2014 (galioja iki 2026-01-02)
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) Ω		
Nuolatinė įtampa (0 ... 1050) V		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V		
Kintama įtampa (0 ... 1000) V		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 U) V		
Kintamos srovės stipris (0 ... 1000) A		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,05 I) A		
Dažnis (15 ...1200) Hz		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,001 f) Hz		
Talpis (0,01 ... 50) μF		
didžiausia leidžiamoji paklaida ± (0,15 C) μF		
Srovės replės skaitmeninės:		
įtampa (0 ... 1000) V		
leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,5 %		
srovė (0 ... 1000) A,		
leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,5 %		
varža (0 Ω iki 400 MΩ),	Metrologinė patikra	BPM 8871101-71:2002
leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,1		
dažnis (0,5 Hz iki 10 MHz),		
leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,1 %		
talpa (0,5 nF iki 40 mF), leidžiamoji paklaida ≥ ± 1,0 %		
METREL EUROTTEST MI 3102,MI3102H,MI3101,MI3105; MI3102H CL; MI3102H BT; MI3152H		
Varžos matavimas		
(0 ... 199,9) MΩ ± 0,5%;		
(0 ... 999) MΩ ± (2 - 10) %;		
(0 ... 19,99) Ω ± 3 %;		
(20 ... 1999) Ω ± 5 %		
Įtampas matavimas (0 - 1200) V ± 3 %;	Metrologinė patikra	PM 135896117-03:2010 (galioja iki 2026-01-02) SPM 135896117-02:2018 (galioja iki 2026-01-02)


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
(0 ... 500) V (50 Hz) ± 2 % Srovės matavimas (0 ... 99,9) mA ± 5 %; (100 mA iki 19,99 A) ± 5%		
LAIKO IR DAŽNIO MATAVIMO PRIEMONĖS		
Transporto priemonių greičio matavimo sistemos greičio matavimo ribos (20 ... 250) km/h greičio matavimo paklaida ≤± 1 km/h iki 100 km/h ≤± 1 % virš 100 km/h ≤± 2 km/h iki 100 km/h ≤± 2 % virš 100 km/h ≤± 3 km/h iki 100 km/h ≤± 3 % virš 100 km/h	Metrologinė patikra	BPM 8871101-134:2013 (galioja iki 2026-01-10)
Automobilių stovėjimo laiko apmokestinimo sistema. Laiko paklaida ± 20 s per 7 paras	Metrologinė patikra	PM 120229395-18:2008 (galioja iki 2026-03-21) PM 111510685-08:2010 (galioja iki 2026-03-21) PM 160430566-10:2010 (galioja iki 2026-03-21) PM 302250087-03:2012 (galioja iki 2026-03-21) SPM 120229395-01:2022 (galioja iki 2026-03-21)
Sekundmačiai mechaniniai iki 60 min, paklaida ± 0,8 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-60:2002
Sekundmačiai skaitmeniniai 9999,9 s, paklaida ≤ ± 5 s/para	Metrologinė patikra	BPM 8871101-119:2007 Pakeitimas 1
Taksometrai Nuvažiuoto nuotolio fiksavimo paklaida ± 2 % Išmatuoto laiko paklaida ± 0,2 %	Metrologinė patikra	BPM 120229395-90:2016
OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS		
Spektrofotometrai (220...900) nm Paklaida ± 0,5 nm ir didesnė (0...2) A Paklaida ± 0,002 A ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-62:2005
Refraktometrai (1,32...1,7) n _d Paklaida ±1×10 ⁻⁴ n _d ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-59:2003
Poliarimetrai 100...+100)°Z	Metrologinė patikra	BPM 8871101-130:2008

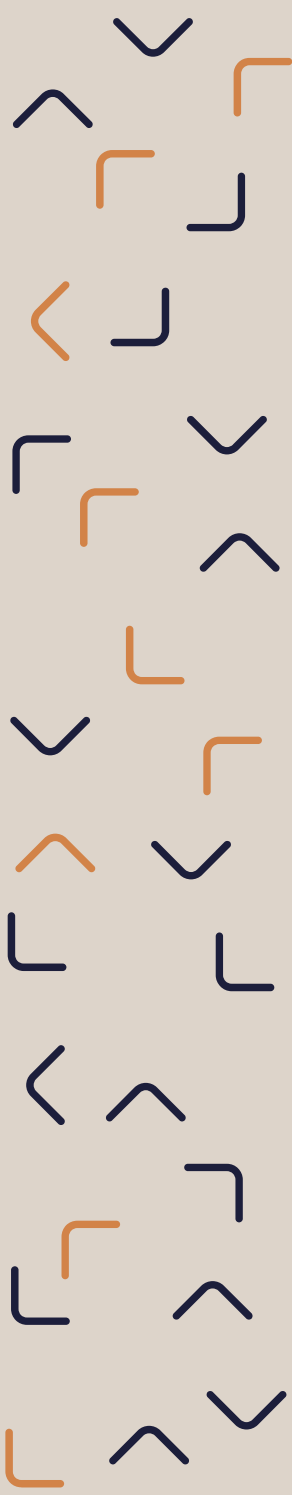

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Paklaida ±0,02 °Z ir didesnė (-41...+41)° Paklaida ±0,03 ° ir didesnė		
FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ MATAVIMŲ PRIEMONĖS		
Medienos drėgmėmačiai Drėgmės matavimo ribos (2 ... 100) %, leidžiamoji absoliutinė paklaida ≤ ± 4 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-123:2008
Pieno analizatoriai (laktoskopai) (0...7) % riebalų Paklaida ±1 % ir didesnė (0...5) % baltymų Paklaida ±1 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008
Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai temperatūra (0 ... 55)°C, paklaida ± 0,3 % ir didesnė deguonies koncentracija (0 – 199,9) mg/l (0 ... 600) % O ₂ paklaida ± 0,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-117:2007
Alkoholio koncentracijos išskvepiamame ore matavimo priemonės, alkoholio koncentracijos β matavimo ribos nuo(0 iki β max) mg/l Leidžiamoji paklaida: pagal OIML R 126: β<0,4 mg/l ± ≤ (0,02...0,03) mg/l 0,4 mg/l ≤ β ≤ 2,0 mg/l ± ≤ (5...7,5)% β > 2,0 mg/l ± ≤((β/2-0,9)...((3·β)/4-1,35)) mg/l; pagal LST EN 15964: β ≤ 0,2 mg/l ± ≤ 0,02 mg/l β > 0,2 mg/l ± ≤ 10%	Metrologinė patikra	BPM 111950581-78:2024
pH matuokliai (-2...12,45) pH Paklaida ± 0,01 pH ir didesnė (-1900...+1900) mV Paklaida ±1 mV ir didesnė 0,01 μS/cm...19,00 mS/cm Paklaida ±1,5 % ir didesnė (0...19) mg/l O ₂ Paklaida ± 1,5 % ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-75:2003
Grūdų kritimo skaičiaus matavimo analizatoriai (62...1000) s, paklaida ±1 s ir didesnė	Metrologinė patikra	BPM 140216494-149:2014
TEMPERATŪROS MATAVIMO PRIEMONĖS		

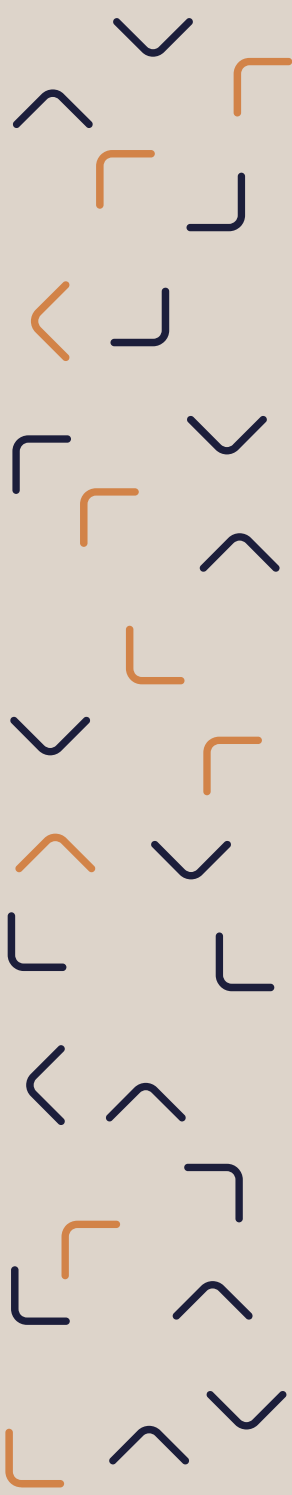


Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Psichrometrai: temperatūros matavimo ribos (-30 - +50) °C, leidžiamoji absoliutinė paklaida $\geq \pm 0,1$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 1 pakeitimas
Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės temperatūros matavimo ribos (-50 - +70) °C, leidžiamoji absoliutinė paklaida $\geq \pm 0,1$ °C santykinės drėgmės matavimo ribos (10...100)%, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1,5$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008 1 pakeitimas
Stikliniai skysčio termometrai (-50...+600) °C 1, 2 tikslumo klasė, paklaida $\pm (0,1...15)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-21:2024
Skaitmeniniai termometrai (-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,1$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-22:2000 (galioja iki 2026-01-15)
Maksimalūs elektriniai termometrai + (32... 42) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,15$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-103:2006 (galioja iki 2026-01-15)
Manometriniai termometrai (-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,5$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-23:2000
Termometrai su ciferblatu (-50... +600) °C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1,0$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-101:2006
Infraraudonųjų spindulių termometrai (-30 - +300)°C, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 1$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-128:2008
Temperatūros jutiklių poros (-65... + 650) °C, absoliutinė paklaida ± 2 °C; temperatūrų skirtumo paklaida $\pm (0,5 + 3Q_{min}/Q)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-73:2003
Varžiniai temperatūros jutikliai be keitiklių (-40 ... +300) °C, tiksl. kl. AA, A, B, C, D paklaidos $\pm(0,1+0,0017 t ...1,2+0,12 t)$ °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-51:2024
SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONĖS		
Automobilių padangų slėgmačiai: kai $p \leq 0,4$ MPa, slėgio matavimo paklaida ($\pm$ kPa) 8, esant apl. temp. (15...25)°C; $0,5 \cdot (15 - t_{apl}) + 8$, kai ≤ 15 °C; $0,5 \cdot (t_{apl} - 25) + 8$, kai ≥ 25 °C; kai $p = (0,4...1,0)$ MPa, slėgio matavimo paklaida ($\pm$ kPa) 16, esant apl. temp. (15...25)°C; $0,5 \cdot (15 - t_{apl}) + 16$, kai ≤ 15 °C; $0,5 \cdot (t_{apl} - 25) + 16$, kai ≥ 25 °C; kai $p > 1,0$ MPa,	Metrologinė patikra	BPM 120229395-40:2015

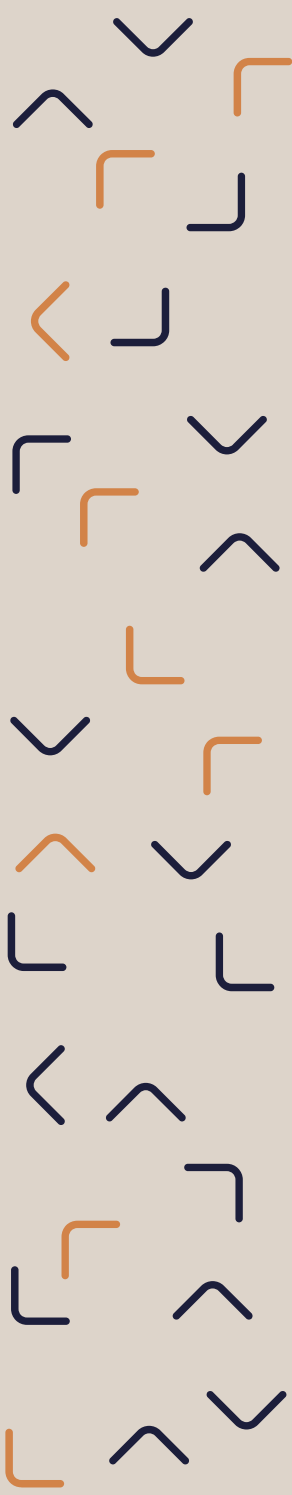

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
slėgio matavimo paklaida (± kPa) 25, esant apl. temp. (15...25)°C; 0,5·(15-tapl)+25, kai ≤15°C; 0,5·(tapl-25)+25, kai ≥ 25°C		
Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai (į srovės signalą) matavimo ribos (-0,095 - 70,0) MPa, tikslumo klasė ≥ 0,075	Metrologinė patikra	BPM 8871101-24:2011
Neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai (neautomatizuoti): ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ±3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i) kPa didžiausia leidžiamoji histerezės paklaida: ± 4mmHg ±0,5kPa	Metrologinė patikra	BPM 120229395-05:2015
Neinvaziniai automatiniai kraujospūdžio matuokliai: ribos (0...260) mmHg (0...35) kPa paklaidos: prie aplinkos temperatūros (15...25)°C ±3 mmHg ± 0,4 kPa prie aplinkos temperatūros (10...40)°C ± (3 arba ≤2%·p _i) mmHg ±(0,4 arba ≤2%·p _i)kPa didžiausia vidutinė matavimo paklaida ±5mmHg ± 0,7kPa	Metrologinė patikra	BPM 8871101-27:2018
Barometrai Atmosferinio slėgio matavimo ribos (800-1060) hPa Slėgio matavimo paklaida ±2 hPa Temperatūrinis koeficientas ±0,16 hPa /°C	Metrologinė patikra	PM 9074324-17:2000
SKYSČIŲ IR DUJŲ KIEKIO MATAVIMO PRIEMONĖS (TŪRIS, DEBITAS, KIEKIS, LYGIS)		
Techniniai saikikliai vienos reikšmės V _v < 50000 dm ³ daugelio reikšmių V _v < 2500 dm ³ 1 ir 2 tikslumo klasė	Metrologinė patikra	BPM 8871101-34:2001
Stikliniai butirometrai ribos (0 ... 40) % riebalų masės leidžiamoji paklaida ≥ ±0,01 % V = (0,125 ... 2,252) ml leidžiamoji paklaida ≥ ±0,00313 ml	Metrologinė patikra	PM 2022939-43:96
Stikliniai tūrio matavimo indai Būrėtės (1 ... 100) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Pipetės: (0,1 ... 200) cm ³ , A, AS, 1, B, 2 tikslumo klasė Kolbos (1 ... 5000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Cilindrai (5... 2000) cm ³ , A, 1, B, 2 tikslumo klasė Menzūros (50 ... 1000) cm ³ , paklaida ≥ ± 2,5 cm ³ Mėgintuvėliai (5 ... 25) cm ³ , paklaida ≥ ± 0,1 cm ³	Metrologinė patikra	BPM 8871101-17:2013

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: S. Raštikio g. 26, Kaunas		
Piknometrai (1 ... 100) cm ³ , paklaida $\geq \pm 0,1$ cm ³		
Laboratoriniai skysčių dozatoriai V = (0,001 ... 200) ml, leidžiamoji paklaida $\geq \pm 0,2$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Dozatoriai alkoholiui: V = (10 ... 50) ml, leidžiamoji paklaida ± 3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-32:2001 1 keitimas
Tūrio dozavimo matai: V _V = (0,02 ... 5) dm ³ , leidžiamoji paklaida $\geq \pm 2$ cm ³ arba $\geq \pm 3$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-33:2013
Plastikiniai tūrio indai: plastikiniai tūrio indai: V _V = (0,005 ... 5) dm ³ , A ir B tikslumo kl.	Metrologinė patikra	BPM 8871101-131:2008
Vandens skaitikliai atviriems kanalams su Paršalio, Venturi, Khafagi-Venturi, Palmer_Bowlus latakais arba su stačiakampėmis ar trikampėmis užtvankomis Debito matavimo neapibrėžtis $\geq \pm 2,5$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-80:2004
Ultragarinis skysčio kiekio skaitiklis atviriems kanalams LMA-01 (50 ... 1000) mm ± 2 mm Skysčio kiekio skaičiavimo paklaida $\pm 1,5$ % ir didesnė	Metrologinė patikra	PM 3268601-12:2001 Pakeitimas 1
Nuotekų kiekio skaitiklis SNU100 lygio matavimo paklaida ± 2 mm $\pm 0,3$ % nuo maksimalios matavimo ribos	Metrologinė patikra	PM 165707056-08:2013
Skystų produktų talpyklos: V _V = (3...200) m ³ , leidžiamoji paklaida $\pm 0,3$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-96/1:2005 BPM 8871101-96/2:2005
Mažos talpyklos: V _V ≤ 35 m ³ leidžiamoji paklaida $\pm 0,5$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-109:2013
Alyvos kolonėlės 1 - 100 dm ³ , tūrio matavimo paklaida $\pm 1,0$ %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-68:2002

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Aukštaičių g. 43 Kaunas		
Šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...150) m ³ /h Karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...16) m ³ /h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: Q _{min} ≤ Q < Q _t – ± 5 % (nepriklausomai nuo vandens temp.)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023

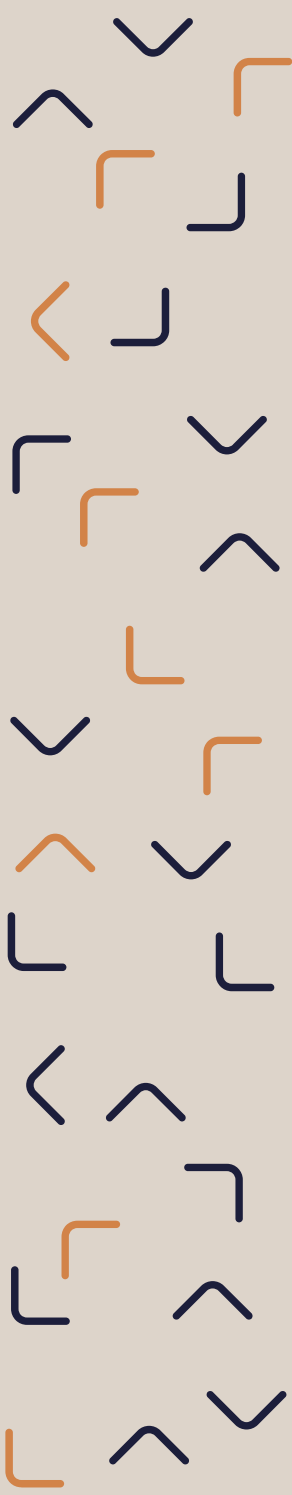

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, nėeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
$Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)		
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav		
Šalto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,006...15) m³/h Karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,006...2.5) m³/h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023
Šilumos energijos skaitikliai srauto jutiklio sąlyginis skersmuo $D_s < 150$ mm tikslumo klasė 2; 4; 5 (OIML R75) 1; 2; 3 (OIML R75-1, EN 1434-1)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-45:2023
Ultragarsiniai vandens ir šilumos kiekio skaitikliai SKU-01, SKU-01M debito jutiklio sąlyginis skersmuo $D_s \geq 150$ mm, vandens kiekio leidžiamoji paklaida $\pm (2 + 0,02q_p/q)\%$; temperatūrų skirtumo $\pm 0,5$ K; šilumos kiekio $\pm (2,5+3/\Delta T+0,02q_p/q + Et)\%$	Metrologinė patikra	PM 3268601-02-97
Kauno regiono laboratorija (C tipo kontrolės įstaiga), veiklos vykdymo vietos adresas: Velžio kelias 13, Panevėžys		
Šalto ir karšto vandens skaitikliai Debito matavimo ribos (0,015...10) m³/h vandens tūrio matavimo paklaida, esant debitui: $Q_{min} \leq Q < Q_t - \pm 5\%$ (nepriklausomai nuo vandens temp.) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 2\%$ (esant vandens temp. iki 30 °C) $Q_t \leq Q \leq Q_n - \pm 3\%$ (esant vandens temp. virš 30 °C)	Metrologinė patikra	BPM 111955219-29:2023

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas